




Date :	N° de commande :
Nom :	Prénom :
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :


CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL		

<p align="center">Courroie d'appui-mollet coussinée simple 4 po</p>  <p><input type="checkbox"/> MI712066 \$ <input type="checkbox"/> MI7520-... Avec Gel112 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center">Courroie d'appui-mollet coussinée double 8 po</p>  <p><input type="checkbox"/> MI712577 \$ <input type="checkbox"/> MI7525-... Avec Gel148 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center">Courroie au pied</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7250.....26 \$ ouverture maximale 12 po</p>
---	---	--

<p align="center">Cale-pied</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7135.....40 \$ Réglable par sa fixation de Velcro</p>	<p align="center">Chevillère</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7140 #1: 6 ½" à 8 ½"61 \$ <input type="checkbox"/> MI7145 #2: 8 ½" à 10"61 \$ <input type="checkbox"/> MI7150 #3: 10" à 12 ½"61 \$</p>	<p align="center">Protège-genou</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7215 Droite.....86 \$ <input type="checkbox"/> MI7220 Gauche.....86 \$</p>
--	---	---

<p align="center">Talonnère</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7130 2".....21 \$ <input type="checkbox"/> MI7131 4".....33 \$ <input type="checkbox"/> MI7133 4" avec coussinage en néoprène.....40 \$</p> <p>Permet un ajustement en profondeur</p>	<p align="center">Courroie stabilisatrice aux genoux</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7195.....216 \$</p> <p>Largeur fauteuil : _____ Largeur genoux : _____</p>	<p align="center">Équerre correctrice</p>  <p>L'épaisseur standard est ½", l'abs ¼" et plastazote ¼"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7025 Équerre correctrice coussinée/pied.....60 \$ <input type="checkbox"/> MI7040 Housse.....35 \$</p> <p>Fabriqué selon vos spécifications</p> <p>H : _____, P : _____, E : _____</p>
--	---	--

Bottine rigide






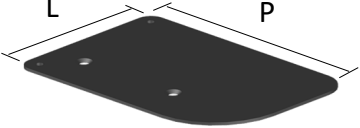
LI : Largeur interne
PI : Profondeur interne
H : hauteur de la bottine

MI7230.....109 \$
Petite LI: 2½", PI: 4", H: 1½"


MI7235.....109 \$
Moyenne LI : 4" , PI : 5½", H : 1¾"

MI7240.....109 \$
Grande LI : 6" , PI : 8" , H : 1¾"


MI7245.....135 \$
Personnalisée selon vos mesures: LI : _____ PI : _____ H : _____

Gaine protectrice		Palette d'appui-pied en ABS ¼	
			
Pleine longueur	Oeillet	Velcro	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
Pleine longueur en néoprène <input type="checkbox"/> MI7300 - Gauche.....36 \$ <input type="checkbox"/> MI7300 - Droit.....36 \$		<input type="checkbox"/> MI7045: Palette d'appui-pied coussinée.....95 \$ <input type="checkbox"/> MI7046: Palette d'appui-pied en ABS ¼"80 \$ <input type="checkbox"/> MI7050: Palette d'appui-pied avec antidérapant.....88 \$ <input type="checkbox"/> MI7055: Coussinage palette d'appui-pied (sans la housse)20 \$ <input type="checkbox"/> MI7060 Housse Dartex <input type="checkbox"/> Cuirette <input type="checkbox"/>62 \$	
À hauteur du genou en néoprène (œillet) <input type="checkbox"/> MI7301 - Gauche.....31 \$ <input type="checkbox"/> MI7304 - Droit.....31 \$		Fabriqué selon vos spécifications. Dimensions maximums: Largeur 8", Profondeur 8". Pour autres mesures, voir section palette d'appui-pied coussinée pleine grandeur ABS ¼". L: _____, P: _____	
À hauteur du genou en néoprène (velcro) <input type="checkbox"/> MI7303 - Gauche.....31 \$ <input type="checkbox"/> MI7302 - Droit.....31 \$			
Non-standard <input type="checkbox"/> MI7443* - Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>52 \$ ch. *Veuillez nous envoyer votre dessin			


Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS ¼

<input type="checkbox"/> MI7288: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS avec antidérapant.....148 \$	
<input type="checkbox"/> MI7289: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS115 \$	
<input type="checkbox"/> MI7290: Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS 1/4.....165 \$	
<input type="checkbox"/> MI7295 : Coussinage palette d'appui-pied pleine largeur80 \$	
<input type="checkbox"/> Housse Dartex <input type="checkbox"/> Cuirette	
Fabriqué selon vos spécifications L: _____, P: _____	

Boîte d'appui-pieds

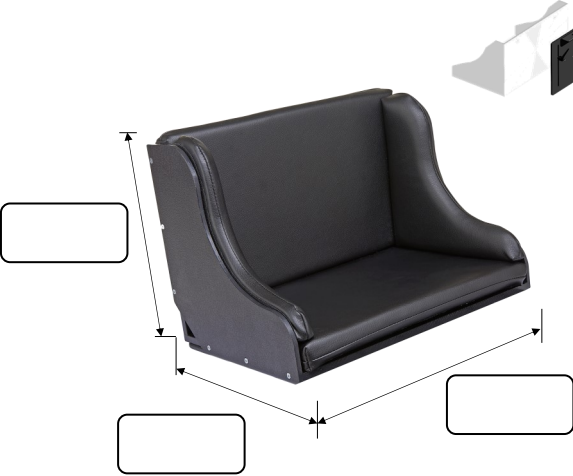	<input type="checkbox"/> MI7066 Boîte d'appui-pieds.....452 \$
	<input type="checkbox"/> MI7070 Boîte d'appui-pieds structure d'ABS.....263 \$
	<input type="checkbox"/> MI7085 Mécanisme multi réglable96 \$
	<input type="checkbox"/> MI7115 Équerres (2 unités).....18 \$
	* Inscrivez les mesures désirées dans les cases réservées à cet effet.
Choix de mousse	
<input type="checkbox"/> VR10091 Sunmate mou 1".....40 \$	
<input type="checkbox"/> VR10093 Temper T-36 1".....89 \$	
<input type="checkbox"/> VR10073 Viscose 1"26 \$	
<input type="checkbox"/> VR10110 Sunmate mou ½".....23 \$	
<input type="checkbox"/> VR10111 Temper T-36 ½".....44 \$	
<input type="checkbox"/> VR10074 Viscose ½".....17 \$	

Stabilisateurs simples aux genoux

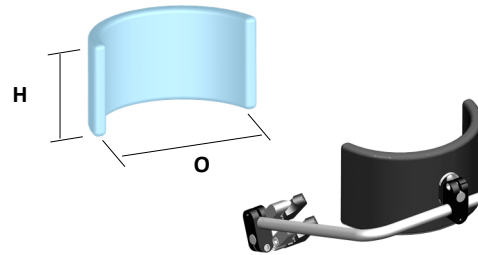

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Stabilisateur au genou (système d'ancrage + coussin)					
<input type="checkbox"/>	MI7181-...	X petit	3 po	3 ½ po	216 \$
<input type="checkbox"/>	MI7182-...	Petit	4 po	4 po	216 \$
<input type="checkbox"/>	MI7183-...	Moyen	5 po	4 ½ po	216 \$
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> Gauche			

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Coussin de remplacement					
<input type="checkbox"/>	MI7155	X petit	3 po	3 ½ po	56 \$
<input type="checkbox"/>	MI7160	Petit	4 po	4 po	56 \$
<input type="checkbox"/>	MI7165	Moyen	5 po	4 ½ po	56 \$

Choix	N° de produits	Description
<input type="checkbox"/>	...-1	Ancrage pour tube de ¾"
<input type="checkbox"/>	...-2	Ancrage pour tube de ⅞"
<input type="checkbox"/>	...-3	Ancrage pour tube de 1"
<input type="checkbox"/>	...-4	Ancrage pour tube de 1 ⅛"

Notes