













2019-05-16

Date :	N° de commande :
Nom:	Prénom:
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL		

<p align="center">Courroie d'appui-mollet coussinée simple 4 po</p>  <p><input type="checkbox"/> MI712066 \$ <input type="checkbox"/> MI7520 Avec Gel93 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center">Courroie d'appui-mollet coussinée double 8 po</p>  <p><input type="checkbox"/> MI712577 \$ <input type="checkbox"/> MI7525 Avec Gel123 \$</p> <p>Veuillez spécifier la largeur du fauteuil roulant :</p>	<p align="center">Courroie au pied</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7250.....26 \$ ouverture maximale 12 po</p>
<p align="center">Cale-pied</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7135.....40 \$ Réglable par sa fixation de Velcro</p>	<p align="center">Chevillère</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7140 #1: 6 ½" à 8 ½".....53 \$ <input type="checkbox"/> MI7145 #2: 8 ½" à 10".....53 \$ <input type="checkbox"/> MI7150 #3: 10" à 12 ½".....53 \$</p>	<p align="center">Protège-genou</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7215 Droite.....68 \$ <input type="checkbox"/> MI7220 Gauche.....68 \$</p>
<p align="center">Talonnière</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7130 2".....21 \$ <input type="checkbox"/> MI7131 4".....30 \$ <input type="checkbox"/> MI7133 4" avec coussinage en néoprène...35 \$</p> <p>Permet un ajustement en profondeur</p>	<p align="center">Courroie stabilisatrice aux genoux</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7195.....125 \$</p> <p>Largeur fauteuil : _____ Largeur genoux : _____</p>	<p align="center">Bottine rigide</p>  <p>LI : Largeur interne PI : Profondeur interne H : hauteur de la bottine</p> <p><input type="checkbox"/> MI7230.....70 \$ Petite LI : 2½", PI : 4", H : 1½"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7235.....70 \$ Moyenne LI : 4" , PI : 5½", H : 1½"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7240.....70 \$ Grande LI : 6", PI : 8", H : 1½"</p> <p><input type="checkbox"/> MI7245.....125 \$ Personnalisée selon vos mesures:</p> <p>LI : _____ PI : _____ H : _____</p>
<p align="center">Gaine protectrice</p>  <p><input type="checkbox"/> MI7300 pleine largeur en néoprène.....27 \$ <input type="checkbox"/> MI730231 \$ À hauteur du genou en néoprène - Droit <input type="checkbox"/> MI7303.....31 \$ À hauteur du genou en néoprène - Gauche</p>	<p align="center">Contour correcteur souple</p>  <p>MI7000 L'unité90 \$ Petit : L : 3½" P: 6" <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite MI7005 L'unité90 \$ Grand : L : 5½" P: 9" <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> MI7400.....117 \$ Personnalisée selon vos mesures L: _____, P: _____</p>	

Équerre correctrice




L'épaisseur standard est ½", l'abs ¼" et plastazote ¼"

MI7025 Équerre correctrice coussinée/pied.....52 \$
 MI7040 Housse.....30 \$

Fabriqué selon vos spécifications
H : _____, **P :** _____, **E :** _____

Palette d'appui-pied en ABS ¼


Gauche
 Droite



MI7045: Palette d'appui-pied coussinée.....82 \$
 MI7046: Palette d'appui-pied en ABS ¼"69 \$
 MI7050: Palette d'appui-pied avec antidérapant.....76 \$
 MI7055: Coussin palette d'appui-pied17 \$
 MI7060 Housse Dartex Cuirette 54 \$

Fabriqué selon vos spécifications. Dimensions maximums: Largeur 8", Profondeur 8". Pour autres mesures, voir section palette d'appui-pied coussinée pleine grandeur ABS ¼".
L : _____, **P :** _____


Contour correcteur coussinée pied



MI7010.....71 \$

Fabriqué selon vos spécifications
L : _____, **P :** _____, **H :** _____


Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS ¼



MI7288: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS avec antidérapant.....129 \$
 MI7289: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS100 \$
 MI7290: Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS 1/4.....152 \$
 MI7295 : Coussinage palette d'appui-pied pleine largeur52 \$
 Housse Dartex Cuirette

Fabriqué selon vos spécifications **L :** _____, **P :** _____

Boîte d'appui-pieds

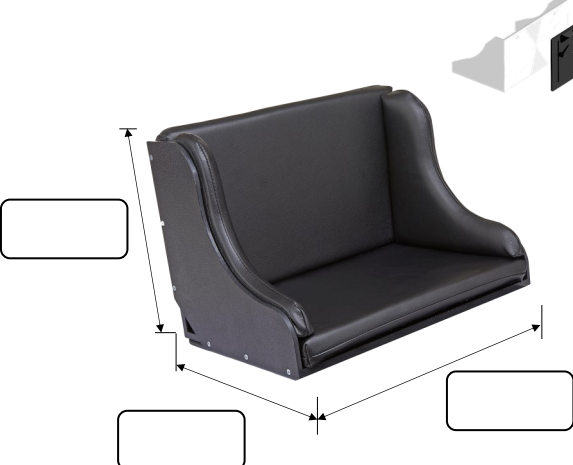


MI7066 Boîte d'appui-pieds.....387 \$
 MI7070 Boîte d'appui-pieds structure d'ABS.....263 \$
 MI7085 Mécanisme multi réglable83 \$
 MI7115 Équerres (2 unités).....18 \$

* Inscrivez les mesures désirées dans les cases réservées à cet effet.

Choix de mousse

VR10091 Sunmate mou 1".....40 \$
 VR10093 Temper T-36 1".....89 \$
 VR10073 Viscose 1"26 \$
 VR10110 Sunmate mou ½".....23 \$
 VR10111 Temper T-36 ½".....44 \$
 VR10074 Viscose 1"17 \$

Stabilisateurs simples aux genoux

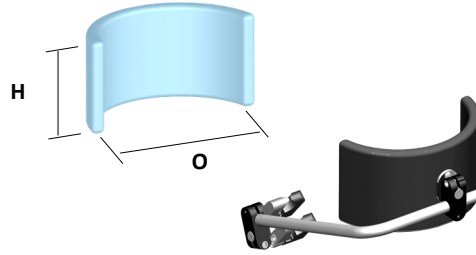

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Stabilisateur au genou (système d'ancrage + coussin)					
<input type="checkbox"/>	MI7181-...	X petit	3 po	3 ½ po	153\$
<input type="checkbox"/>	MI7182-...	Petit	4 po	4 po	153\$
<input type="checkbox"/>	MI7183-...	Moyen	5 po	4 ½ po	153\$
<input type="checkbox"/> Droite		<input type="checkbox"/> Gauche			

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Coussin de stabilisateur au genou					
<input type="checkbox"/>	MI7155	X petit	3 po	3 ½ po	43\$
<input type="checkbox"/>	MI7160	Petit	4 po	4 po	43\$
<input type="checkbox"/>	MI7165	Moyen	5 po	4 ½ po	43\$

Choix	N° de produits	Description
<input type="checkbox"/>	...-1	Ancrage pour tube de ¾"
<input type="checkbox"/>	...-2	Ancrage pour tube de ⅞"
<input type="checkbox"/>	...-3	Ancrage pour tube de 1"
<input type="checkbox"/>	...-4	Ancrage pour tube de 1 ⅛"

Notes