

NEOX^{MC} DYNAMIC



Manuel d'utilisation



Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

FRANÇAIS

Manuel d'utilisateur : NEOX^{MC} DYNAMIC

Base de positionnement

Les Équipements adaptés Physipro Inc. est fière de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Les Équipements adaptés Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Pour Les Équipements adaptés Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

Information sur votre Neox^{MC} DYNAMIC :
Date d'achat :
Numéro de série :
Centre de réadaptation/Distributeur :
Adresse :
Téléphone :

Table des matières

1. Plan de l'appareil	7
Composants standards	8
Composants optionnels	9
2. Spécifications techniques.....	10
3. Recommandations	16
Vérifications d'usage	16
Règles de sécurité	17
Avertissements d'ordre général	18
Se familiariser avec votre nouvelle base de positionnement	18
Limite de poids	18
Conditions environnementales	18
Entraînement avec poids et activités sportives	19
Utilisation dans la rue	19
À l'attention des préposés	20
Avertissements : chute et basculement.....	21
Se vêtir	21
Atteindre un objet, se pencher ou se plier	21
Transferts	22
Obstacles	22
Monter un trottoir ou une seule marche.....	23
Descendre un trottoir ou une seule marche	24
Monter et descendre un escalier	24
Escaliers roulants	25
Centre d'équilibre.....	25
Monter et descendre une pente ou une rampe	25
Déplacement à reculons	27
Cabrage	27
4. Instructions	28
Outils nécessaires	28
Hauteur siège/sol	29
Modifier la position du bloc d'ancrage des roues motrices.....	30
Modifier la position des roues pivotantes	31

FRANÇAIS

Roues motrices.....	32
Installer les roues motrices avec l'essieu fileté.....	32
Désinstaller l'essieu fileté	32
Installer les roues motrices avec l'essieu à dégagement rapide	33
Désinstaller l'essieu à dégagement rapide.....	33
Ajuster l'essieu à dégagement rapide.....	33
Utiliser le système d'essieu à dégagement rapide	34
Déplacement horizontal des roues motrices	34
Déplacement latéral des roues motrices.....	34
Pneus à pression (option).....	36
Fourches escamotable (option 6 roues)	37
Installer le mécanisme de fourche escamotable.....	37
Franchir des obstacles – Mécanisme de fourche escamotable	37
Roues pivotantes	39
Assembler et installer la fourche	39
Installer les roues pivotantes	40
Siège	41
Modifier la profondeur de siège	41
Modifier la largeur de siège (Option).....	42
Ceinture pelvienne de positionnement.....	43
Dossier	44
Modifier la hauteur des montants de dossier.....	44
Dossier standard	45
Modifier l'angle de dossier standard	45
Retirer le dossier standard.....	45
Dossier dynamique.....	46
Installer le dossier dynamique	46
Modifier l'angle du dossier dynamique.....	47
Régler la tension du dossier dynamique	47
Dossier inclinable par vérin	48
Installer le mécanisme d'inclinaison par vérin.....	48
Modifier l'angle du dossier inclinable	49
Installer la barre de tension	50
Installer le support d'appui-tête sur la barre de tension.....	50
Installer la barre de poussée réglable en angle (option)	51
Ajuster l'angle de l'extension de la barre de poussée.....	52
Installer la poignée d'activation	52
Bascule.....	53
Bascule Standard	53

Accoudoirs.....	56
Accoudoir en « U ».....	56
Accoudoir en « T »	57
Repose-jambe	59
Installer le repose-jambe	59
Retirer le repose-jambe.....	59
Ajuster la hauteur du repose-jambe	59
Rabattre le repose-pied.....	60
Régler en profondeur les palettes du repose-pied	60
Régler l'angle horizontal du repose-pied	60
Ajuster l'angle vertical du repose-pied	60
Repose-jambe élévateur	61
Installer le repose-jambe élévateur	61
Ajustement en hauteur au niveau des genoux	61
Ajuster la longueur du repose-jambe.....	61
Retirer le repose-jambe.....	61
Ajuster l'angle du repose-jambe élévateur	62
Freins de stationnement	62
Installer le système de freinage standard	62
Ajuster la force de freinage appliquée	63
Appliquer les freins.....	63
Frein au pied (option 4 roues ou 6 roues).....	64
Installer le système de freinage au pied	64
Ajuster la force de freinage appliquée	64
Appliquer le frein au pied.....	64
Anti-basculants	65
Installer les anti-basculants	65
Ajustement des anti-basculants	65
Enlever les anti-basculants	65
Dégager les anti-basculants	66
5. Transport	67
6. Nettoyage et Entretien	78
Recommandations générales.....	78
Nettoyage.....	78
Châssis et les surfaces peintes.....	78
Essieux et pièces mobiles	79
Dossier souple	79
Garnitures de confort.....	79
Désinfection	80

FRANÇAIS

Entretien.....	80
Liste de vérification.....	81
Pièces de rechange.....	84
Procédure de réparation.....	84
Établissements offrant des services d'entretien.....	84
7. Rangement et Expédition.....	87
Rangement.....	87
Expédition.....	87
8. Garantie.....	88

1. Plan de l'appareil

NEOX^{MC} Dynamic

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic conçue à partir d'un châssis en aluminium est reconnue pour la versatilité de ses nombreux réglages permettant ainsi d'accompagner l'utilisateur dans l'évolution de ses besoins ainsi que ses changements de conditions cliniques.

Son système de bascule à 30 degrés permet à l'individu de changer l'angle du système d'assise et du dossier durant la journée pour prévenir les points de pression au fessier, d'optimiser son confort ainsi que de lui permettre d'être dans une position de repos. Le point de pivot de la bascule situé complètement à l'avant du châssis de la Neox^{MC} Dynamic permet d'incliner la base de positionnement tout en gardant les genoux approximativement à la même hauteur. Grâce à cet attribut, l'utilisateur est en mesure de se propulser avec ses membres inférieurs peu importe le degré de bascule dans lequel il se trouve.

La Neox^{MC} Dynamic offre une grande gamme de composants optionnels et de nombreux ajustements pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur.


Conçue pour faciliter son usage comme siège dans un véhicule à moteur ou dans le transport adapté, cette base de positionnement a été développée pour des individus de 265 lb et moins.

Elle peut autant convenir à une clientèle adulte qu'à une clientèle gériatrique en perte de mobilité, spastiques ou souffrant de différentes pathologies cliniques. Son utilisation est principalement destinée pour les centres de soins de longue durée, les résidences publiques ou privées pour personnes âgées ainsi que dans les foyers privés des usagers. Une utilisation dans des environnements extérieurs contrôlés peut aussi être possible.

FRANÇAIS

Composants standards – NEOX^{MC} DYNAMIC

Les composants, illustrés sur l'image ci-dessous, sont fournis sur le modèle standard de la base de positionnement Neox^{MC} Dynamic.

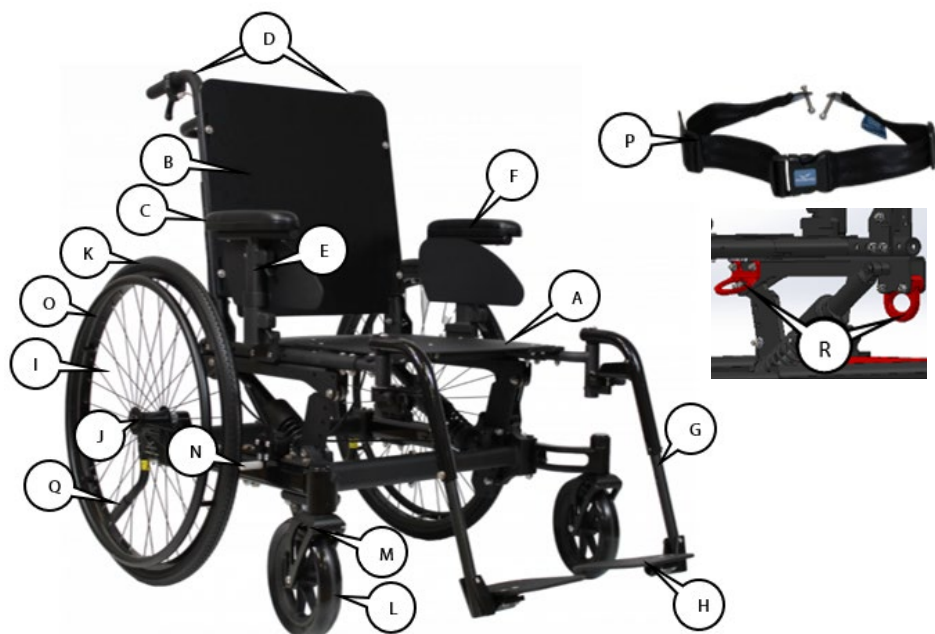**Composants de base– NEOX^{MC} DYNAMIC**

A	Base de siège rigide, réglable en profondeur
B	Dossier, plaque rigide
C	Montant de dossier droit, réglable en angle et en hauteur
D	Poignée de poussée surélevée et orientable, avec gaine de préhension
E	Accoudoir court, rabattable ou amovible
F	Garniture d'accoudoir en mousse, courte et plate
G	Potence repose-jambe parallèle, fuselée ou rétrécie, amovible ou pivotant
H	Repose-pied séparé, rabattable, réglable en profondeur et en angle, de longueur standard
I	Roue motrice à rayons, tout diamètre
J	Essieu de roue motrice à montage fixe
K	Pneu de roue motrice semi-dur, tout diamètre
L	Roue pivotante, avec pneu semi-dur, toute dimension

M	Fourche réglable en hauteur
N	Frein de stationnement, actionnement par poussée
O	Cerceaux de conduite lisse
P	Ceinture pelvienne de positionnement
Q	Dispositif antibasculement
R	Points de fixation des sangles d'attache pour le transport

Composants optionnels

Les Équipements adaptés Physipro Inc. offre tout un éventail d'accessoires et d'options permettant de personnaliser chaque base de positionnement en fonction des besoins particuliers de l'utilisateur. Pour de plus amples détails, vous êtes invités à contacter Les Équipements adaptés Physipro Inc. ou à consulter le bon de commande.

Composants optionnels de substitution – NEOX ^{MC} DYNAMIC	
	Dossier souple réglable en tension
	Barre de poussée surélevée et orientable, avec gaine de préhension
	Accoudoir, long rabattable ou amovible,
	Garniture d'accoudoir en mousse longue, plate
	Garniture d'accoudoir en mousse, profilée
	Garniture d'accoudoir en gel
	Repose-jambe élévateur compensateur
	Repose-pied séparé rabattable, réglable en profondeur et en angle, de longueur surdimensionnée
	Repose-pied rabattable, pleine largeur, réglable en angle et en profondeur
	Roue motrice en plastique, tout diamètre
	Essieu de roue motrice à dégagement rapide
	Pneu de roue motrice à chambre d'air, à pression standard, tout diamètre
	Frein de stationnement, actionnement par traction
	Cerceau de conduite plastifié

FRANÇAIS

Composants optionnels d'ajout – NEOX^{MC} DYNAMIC

Dossier inclinable
Protège-vêtement
Appui-mollet rembourré en mousse, réglable en angle, en hauteur et en profondeur, incluant coussin plat ou profilé
Courroie d'appui-mollet coussinée, simple
Courroie d'appui-mollet coussinée, double
Cale-talonnière réglable
Rallonge de levier de frein; télescopique ou fixe
Protège-rayons
Dispositifs réfléchissants
Barre de tension de dossier
Ancrage d'appui-tête pour barre de tension de dossier, permettant un ajustement en hauteur avec ancrage d'appui-tête
Support d'appui-tête, réglable en hauteur, en profondeur et en angle
Coussin profilé d'appui-tête, tout format

Autres composants optionnels disponibles – NEOX^{MC} DYNAMIC

Frein au pied
Bascule motorisée contrôlée par l'occupant
Porte-cannes simple ou double
Support pour bouteille d'oxygène

2. Spécifications techniques**NEOX^{MC} DYNAMIC****SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Nom du fabricant	Les Équipements adaptés Physipro Inc.
Modèle	Base de positionnement Neox ^{MC} Dynamic
Capacité maximale de charge	265 lb (120 kg)
Catégorie	BPO-GM-2-C-P1

DIMENSION DE L'ASSISE ET DES ROUES	
Angle du plan de siège Méthode de mesure : Dimension 1 : ISO 7176-7, article 7.3.2	0° à 30°
Profondeur effective du siège Méthode de mesure : Dimension 2 : ISO 7176-7, article 7.3.3	14" à 20" (355 mm à 505 mm)
Largeur effective du siège Méthode de mesure : Dimension 4 : ISO 7176-7, article 7.3.5	14" à 22" (355 mm à 560 mm)
Hauteur de la surface du siège au niveau du bord antérieur et postérieur Méthode de mesure : Dimension 5 : ISO 7176-7, article 7.3.6	13" à 19" (330 mm à 480 mm) Réglables par incrément de 1"
Angle du dossier Méthode de mesure : Dimension 6 : ISO 7176-7, article 7.3.7	Montants standards droits : 85° à 120° Montants dynamiques droits : 85° à 110° Réglables par incrément de 5° Dossier inclinable : 85° à 130°, réglable en continu
Hauteur du dossier Méthode de mesure : Dimension 7 : ISO 7176-7, article 7.3.8	Montants standards : 16" à 25" (405 mm à 635 mm) Montants dynamiques : 14 ¾" à 27 ¾" (356 mm à 686 mm) Réglables par incrément de 1"
Distance entre le ou les repose-pieds et le siège Méthode de mesure : Dimension 11 : ISO 7176-7, article 7.3.12	Repose-pied 60° : 11 ¼" à 21" (280 mm à 530 mm) Repose-pied 70° : 10 ¾" à 20 ½" (255 mm à 508 mm) Repose-pied 90° : 10 ½" à 20 ½" (254 mm à 508 mm) Réglables par incrément de ½"
Angle formé par les jambes avec la surface du siège Méthode de mesure : Dimension 15 : ISO 7176-7, article 7.3.16	60°, 70°, 90°
Hauteur des accoudoirs Méthode de mesure : Dimension 16 : ISO 7176-7, article 7.3.17	Accoudoir « T » : 8" à 15 ½" (200 mm à 381 mm) Accoudoir « U » : 6 ¾" à 16 ½" (152 mm à 406 mm) Réglables par incrément de ½"
Diamètre des roues pivotantes Méthode de mesure : Dimension 27 : ISO 7176-7, article 7.3.28	5" (127 mm), 6" (152 mm) et 8" (203 mm)
Diamètre des cerceaux de conduite Méthode de mesure : Dimension 23 : ISO 7176-7, article 7.3.24	Roue 20" (508 mm) : 17 ⅞" (432 mm) Roue 22" (559 mm) : 19 ⅞" (483 mm) Roue 24" (610 mm) : 21 ¼" (533 mm)
Décalage horizontal de l'axe des roues de propulsion Méthode de mesure : Dimension 25 : ISO 7176-7, article 7.3.26	Ajustement de 3" (76 mm), Réglables par incrément de 1"

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ET ESPACE DE MANCEUVRE	
Longueur hors-tout Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.2	Profondeur effective du siège + 27 ½" (686 mm)*
Largeur hors-tout Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.3	Largeur effective du siège + 11" (280 mm)*
Longueur en position repliée Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.5	N/A
Largeur en position repliée Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.6	N/A
Garde au sol Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.14	1" (25 mm)**
Diamètre de braquage Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.13	65 ¼" (1651 mm)
Largeur de demi-tour Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.12	N/A
Largeur de pivot Méthode de mesure : ISO 7176-5, article 8.11	51 ½" (1295 mm)
Hauteur des poignées de préhension	38" (965 mm)
Largeur requise d'un corridor à angle	42 ½" (1080 mm)
Profondeur requise d'une entrée face à une porte	54 ½" (1384 mm)
Largeur requise pour un corridor avec ouverture murale	36 ¾" (924 mm)
Hauteur de soulèvement anti-basculant (Rising)	1 ½" (38 mm)

MASSE DU FAUTEUIL ROULANT	
Masse totale du fauteuil roulant Méthode de mesure : BNQ 6645-001, tableau 10, ligne 10	71,6 lb (32,55 kg)

* Peut varier selon les options sélectionnées - repose-jambes inclus.

** En fonction de la partie la plus basse de l'anti-basculant.

STABILITÉ STATIQUE AVANT DU FAUTEUIL ROULANT

Angle de basculement, roues pivotantes déverrouillées dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 8.2	18,1°
Angle de basculement, roues pivotantes verrouillées dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 8.3	N/A

STABILITÉ STATIQUE ARRIÈRE DU FAUTEUIL ROULANT

Angle de basculement, roues arrière déverrouillées dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 9.2	23,8°
Angle de basculement, roues arrière verrouillées dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 9.3	15,7°

STABILITÉ STATIQUE LATÉRALE DU FAUTEUIL ROULANT

Angle de basculement vers la gauche dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 10.2	22,9°
Angle de basculement vers la droite dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 10.2	22,9°

STABILITÉ STATIQUE DES DISPOSITIFS ANTIBASCULEMENT

Angle de basculement vers l'arrière dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 11.2	22,3°
Angle de basculement vers l'avant dans la configuration la moins stable Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 11.2	N/A
Les dispositifs anti-basculement empêchent-ils le basculement vers l'arrière? Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 11.4	Oui
Les dispositifs anti-basculement empêchent-ils le basculement vers l'avant? Méthode de mesure : ISO 7176-1, article 11.4	N/A
Système de commande de stabilité active	N/A

FRANÇAIS

PERFORMANCE DES FREINS DE STATIONNEMENT

Pente maximale en montée Méthode de mesure : ISO 7176-3, article 7.2	14,1°
Pente maximale en descente Méthode de mesure : ISO 7176-3, article 7.2	10,1°

RÉSISTANCE STATIQUE, RÉSISTANCE AUX CHOCS ET RÉSISTANCE À LA FATIGUE

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic a passé avec succès l'ensemble des certifications et tests ISO reliés à la résistance statique, résistance aux chocs et résistance à la fatigue. La base de positionnement se voit donc conforme aux exigences du document ISO 7176-8.

ININFLAMMABILITÉ DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN POSTURAL
(SIÈGE, DOSSIER, ACCOUDOIRS, ENSEMBLE REPOSE-JAMBE)

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic est équipée de dispositifs de soutien postural (siège, dossier, accoudoirs, ensemble repose-jambes), dont l'ensemble des mousses et tissus utilisés pour leur fabrication répondent aux exigences de la méthode d'essai CAL-117.

UTILISATION COMME SIÈGE DANS LES VÉHICULES À MOTEUR

Déclaration selon laquelle le modèle de fauteuil roulant est conçu pour être fixé face à la route lorsqu'il est utilisé comme siège dans un véhicule à moteur et selon laquelle il est conforme aux exigences du document ISO 7176-19.

Types d'attaches qui sont adaptées au fauteuil roulant (à savoir, sangle à quatre points, système de crampons, type particulier de système d'arrimage, etc.)

Sangle à 4 points. Pour de plus amples informations, voir à consulter la Fiche technique -Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur.

Déclaration selon laquelle le fauteuil roulant est muni des dispositifs de retenue de ceinture fixés au fauteuil roulant indiqués ci-contre, qu'il peut être utilisé avec ceux-ci et qu'il a réussi les essais du document ISO 7176-19.

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic de Physipro^{MD} est munie de dispositifs de retenue de ceinture fixés à même sa structure répondant à la norme ISO/DIS 7176-19:2019 et a réussi les tests d'impact frontal avec un mannequin d'essai de choc ayant une taille moyenne et un poids de 76.3 kg (170 lb). Pour de plus amples informations, voir à consulter la Fiche technique -Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur.

Notation de la facilité à utiliser la ceinture de sécurité à trois points du véhicule à moteur comme l'exige l'article 5.5. a) du document ISO 7176-19.	Excellent
Notation du degré auquel l'utilisation de la ceinture de sécurité à trois points du véhicule à moteur permet de bien sécuriser l'occupant comme l'exige l'article 5.5. b) du document ISO 7176-19.	Excellent
Ne retirez pas les points de fixation des sangles d'arrimage permettant de retenir votre fauteuil roulant à un véhicule à moteur. Si les points de fixation des sangles d'arrimage sont retirés, ils ne pourront être remis en place et votre fauteuil ne sera plus conforme à la norme ISO/DIS 7176-19:19. Pour de plus amples informations, voir à consulter la Fiche technique -Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur.	
Notez que la facilité d'accès et la manœuvrabilité dans les véhicules à moteur peuvent être fortement diminuées par la taille du fauteuil roulant et le diamètre de braquage plus court facilite généralement l'accès au véhicule et la manœuvrabilité en position face à la route. Pour de plus amples informations, voir à consulter la Fiche technique - Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur.	
Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur	<i>Oui. Pour de plus amples informations, voir à consulter la Fiche technique -Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur.</i>

FRANÇAIS

3. Recommandations



AVERTISSEMENT Ne pas utiliser cet équipement sans avoir bien lu et compris le présent manuel d'utilisation dans sa totalité. Celui-ci renferme des informations indispensables qui permettent d'assurer la sécurité de l'utilisateur/utilisatrice et des individus mis en contact avec la base de positionnement.

Vérifications d'usage

Les vérifications suivantes doivent être réalisées pour assurer la sécurité de l'utilisateur lors de la réception de la base de positionnement ainsi qu'aux intervalles d'entretien indiqués dans la liste de vérification :

- ✓ Vérifiez que la base de positionnement est montée avec tous les composants sélectionnés lors de la commande et qu'il n'y ait aucune pièce manquante ou endommagée;
- ✓ Vérifiez que la base de positionnement roule facilement et qu'il n'y ait pas de changement au niveau de l'utilisation habituelle;
- ✓ Assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent sans mouvement saccadé et qu'aucun bruit ou vibration anormal n'est perçu. La présence d'une de ces conditions peut indiquer que les pneus ne sont pas suffisamment gonflés, que des pièces sont desserrées ou que la base de positionnement est abîmée;
- ✓ Assurez-vous que les roues motrices et les roues pivotantes sont solidement fixées et qu'aucun objet n'interfère avec leur bon fonctionnement;
- ✓ Vérifiez si la pression des pneus est adéquate (Uniquement dans les cas de pneus à chambre à air);
- ✓ Assurez-vous de l'efficacité des freins de stationnement;
- ✓ Vérifiez le bon fonctionnement et la solidité des anti-basculants;
- ✓ Assurez-vous que le siège et le dossier sont solidement fixés au châssis et qu'ils sont stables pour l'utilisateur/utilisatrice;
- ✓ Assurez-vous que les accoudoirs sont solidement fixés et verrouillés;
- ✓ Vérifiez que les repose-pieds sont bien ajustés au besoin du client et fixés solidement;
- ✓ Assurez-vous que la ceinture de positionnement soit solidement fixée au châssis et qu'elle est ajustée selon les besoins du client;
- ✓ Assurez-vous qu'aucun objet lourd ne soit fixé au dossier.

Règles de sécurité

De nombreuses règles doivent être appliquées pour assurer la sécurité de l'utilisateur/ utilisatrice et des individus mis en contact avec la base de positionnement. Notez bien que la liste suivante n'est pas exhaustive. Il en va de la responsabilité de la personne mise en contact avec la base de positionnement de demeurer prudente dans les actions entreprises :

- ✓ Ne jamais circuler sans une pression adéquate des pneus (dans le cas de pneus à chambre à air);
- ✓ Ne pas tenter d'atteindre un objet si vous devez vous pencher vers l'avant, sur le côté ou vers l'arrière;
- ✓ Ne pas tenter d'aborder un obstacle dont la hauteur pourrait mettre en péril la stabilité de la base de positionnement;
- ✓ Ne jamais transporter de passager;
- ✓ Ne pas fixer d'autres objets au dossier que ceux fournis avec la base de positionnement;
- ✓ Ne pas tenter de basculer la base de positionnement sans assistance;
- ✓ Ne jamais utiliser les palettes des repose-pieds pour se soulever ou effectuer des transferts;
- ✓ Ne jamais soulever la base de positionnement par ses parties escamotables ou amovibles. Utilisez plutôt les éléments rigides du châssis;
- ✓ Aux endroits où les pièces sont amovibles, attention de ne pas vous pincer un doigt lors de la réinstallation de la pièce;
- ✓ Pour votre sécurité, il est important d'utiliser les points de fixation identifiés de la base de positionnement lors d'un déplacement en transport adapté. Ceux-ci doivent être utilisés avec le système de retenue homologué des véhicules de Transport Canada;
- ✓ Soyez toujours attentif à votre environnement. Prenez quelques instants pour vous familiariser avec les lieux où vous prévoyez utiliser votre base de positionnement, ceci vous permettra de mieux éviter les obstacles et les dangers;
- ✓ Lorsque vous tentez une nouvelle manœuvre, si vous avez des doutes sur la façon sécuritaire de procéder, il est important de demander de l'aide d'un accompagnateur pour assurer votre sécurité;
- ✓ Les Équipements adaptés Physipro Inc. recommande fortement l'utilisation des anti-basculants. En toutes circonstances, l'utilisation des anti-basculants fournit une sécurité supplémentaire et aide à prévenir le basculement de la base de positionnement, réduisant ainsi le risque de chutes et de blessures.



AVERTISSEMENTS AUX PRÉPOSÉS ET ACCOMPAGNATEURS

- ✓ Communiquez toujours vos intentions à l'utilisateur avant de déplacer sa base de positionnement;
- ✓ Ne déplacez jamais une base de positionnement sans vous assurer que l'utilisateur est bien assis et attaché dans sa base pour éviter les chutes;
- ✓ Ne déplacez jamais une base de positionnement sans vous assurer que les pieds de l'utilisateur sont correctement positionnés sur les repose-pieds. Cela évitera que les pieds de l'utilisateur entrent en contact avec les roues et/ou se coincent par inadvertance sous la base lorsqu'elle est poussée, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des chutes.

FRANÇAIS

Avertissements d'ordre général

Se familiariser avec votre nouvelle base de positionnement

- Chaque base de positionnement est unique et nécessite une période d'adaptation. Pour assurer une utilisation sécuritaire de votre base de positionnement, nous vous recommandons de suivre les instructions de votre ergothérapeute et de vous allouer le temps nécessaire pour bien vous familiariser avec le fonctionnement et les caractéristiques de votre nouvelle base de positionnement;
- Commencez par des mouvements simples (se pencher, saisir un objet, effectuer un transfert, tester sa capacité de propulsion, ...). N'hésitez pas de demander de l'aide jusqu'à ce que vous connaissiez les limites de la base de positionnement et que vous ayez développé votre propre méthode d'utilisation.

Limite de poids

- Ne dépassez jamais la limite de poids combiné de l'utilisateur /utilisatrice et des objets transportés. Dépasser la limite de poids augmente le risque de perdre le contrôle de la base de positionnement, de basculer ou de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures graves à l'utilisateur/utilisatrice ou d'autres personnes ainsi qu'endommager de la base de positionnement (Pour vérifier la charge maximale de votre base de positionnement, veuillez consulter la section Spécifications techniques du présent manuel;
- Ne jamais transporter de passager, la base de positionnement est conçue pour une personne seulement.

Conditions environnementales

- Cette base de positionnement a été conçue pour être utilisée sur des surfaces lisses, tel que l'asphalte, le béton et les surfaces intérieures. N'utilisez pas votre base de positionnement sur des terrains accidentés, ni des surfaces instables, tel que le sable, la boue, la neige et la glace. Cela pourrait endommager votre base de positionnement et entraîner une perte de contrôle, augmentant ainsi le risque de chutes et de blessures;
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous effectuez un déplacement sur une surface mouillée ou glissante. En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide;
- Ne jamais utiliser la base de positionnement dans une piscine, une douche ou tout autre site où il y a présence d'eau.

- Évitez l'exposition à l'humidité excessive. Par exemple, ne jamais laisser la base de positionnement dans la salle de bain pendant le bain ou la douche;
- Toujours sécher la base de positionnement s'il est mouillé ou lorsque vous avez terminé de le nettoyer;
- Évitez d'exposer la base de positionnement à des températures extrêmes pour prévenir le risque d'hypothermie ou de brûlure. Les surfaces de la base de positionnement peuvent devenir glaciales à des températures froides ou brûlantes, si exposé à la chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.

Entraînement avec poids et activités sportives

- Nos bases de positionnement ne sont pas conçues pour l'utilisation lors d'activités sportives ou d'entraînements musculaire. L'entraînement avec des poids risque d'endommager la base de positionnement via le dépassement de la limite de poids spécifiée, ce qui causerait l'annulation de la garantie.

Utilisation dans la rue

Les bases de positionnement fabriquées par Les Équipements adaptés Physipro Inc. sont conçues pour un usage majoritairement résidentiel. L'utilisation sur les voies publiques est fortement déconseillée. Si vous devez vous déplacer sur la voie publique, les avertissements et précautions suivantes doivent être observées :

- Soyez conscient qu'en raison de la position basse de votre base de positionnement, les automobilistes peuvent avoir de la difficulté à vous apercevoir. Il est important de vous assurer qu'un contact visuel est bien établi entre vous et l'automobiliste avant de vous déplacer dans un stationnement ou sur une voie publique. Cédez le passage, en cas de doute;
- Des dispositifs réfléchissants sont disponibles en option, ces autocollants doivent être apposés par l'utilisateur ou l'assistant si vous prévoyez utiliser votre fauteuil le soir ou lorsque l'éclairage est faible, nous recommandons de porter des vêtements réfléchissants;
- Lorsque vous vous déplacez sur une voie publique, portez une attention particulière aux dangers et obstacles de la route, tels que les nids de poules et les surfaces dénivelées ou fissurées;
- Ne jamais s'engager sur les voies à circulation dense.

FRANÇAIS**À l'attention des préposés**

- Renseignez-vous auprès d'une personne qualifiée des différentes méthodes et techniques à utiliser pour bien accompagner l'utilisateur/l'utilisatrice de façon sécuritaire;
- Vérifiez que les poignées de poussée sont bien ajustées et verrouillées. Inspectez aussi le revêtement des poignées; les gaines ne doivent pas glisser sur la poignée, ni présenter des signes de détérioration ou de dommage;
- Toujours engager les freins si vous devez laisser l'utilisateur/l'utilisatrice seul(e);
- Ne jamais soulever la base de positionnement par ses parties escamotables ou amovibles, ceux-ci peuvent se détacher en blessant l'utilisateur/l'utilisatrice ou vous-même et/ou endommager la base de positionnement. Utilisez toujours les éléments rigides du châssis pour soulever la base de positionnement;
- Maintenez une bonne posture lorsque vous soulevez ou basculez la base de positionnement: gardez votre dos bien droit et fléchissez vos genoux;
- Communiquez toujours vos intentions à l'usager avant de déplacer sa base de positionnement;
- Ne déplacez jamais une base de positionnement sans vous assurer que l'usager est bien assis et attaché dans sa base pour éviter les chutes;
- Ne déplacez jamais une base de positionnement sans vous assurer que les pieds de l'usager sont correctement positionnés sur les repose-pieds. Cela évitera que les pieds de l'usager entrent en contact avec les roues et/ou se coincent par inadvertance sous la base lorsqu'elle est poussée, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des chutes.

**AVERTISSEMENT**

Ignorer ces avertissements et précautions augmente le risque de perdre le contrôle de la base de positionnement, de basculer ou de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures graves à l'utilisateur/utilisatrice ou d'autres personnes ainsi qu'endommager la base de positionnement.

Avertissements : chute et basculement

Cette section contient des informations indispensables qui permettent de prévenir le risque de chute et/ou basculement, il est important de suivre les précautions et les instructions indiquées.

Lors de vos déplacements, nous recommandons de toujours boucler votre ceinture de positionnement pour une protection accrue.

Se vêtir

Lorsque vous devez vous habiller, tournez les roues pivotantes vers l'avant et engagez les freins.

Si votre base de positionnement n'est pas équipé d'anti-basculants, reculez votre base de positionnement contre un mur.

Atteindre un objet, se pencher ou se plier

Soyez conscient que le centre d'équilibre de votre base de positionnement est affecté lorsque vous effectuez un changement de position. Se pencher ou se plier pour atteindre un objet modifie le centre d'équilibre et diminue votre stabilité.

Certaines précautions sont recommandées pour procéder de façon sécuritaire :

- Placez la base de positionnement le plus près possible de l'objet à atteindre avec les roues pointées vers l'avant. Pour parvenir à positionner la base de positionnement, avancez celui-ci un peu, au-delà de l'objet à saisir, et reculez en le longeant, ceci permet de tourner les roues vers l'avant. Ne bloquez pas les roues motrices, cela crée un point de bascule et augmente le risque de basculement ou de chute;
- Assoyez-vous au fond du siège avec le dos bien appuyé contre le dossier;
- Saisissez l'objet avec une main, en tendant le bras sur le côté et en gardant la main opposée sur l'accoudoir ou le cerceau de conduite;
- Demandez de l'aide d'une autre personne, si possible, ou utilisez une pince de préhension pour saisir l'objet désiré s'il est hors de portée.



AVERTISSEMENT


N'essayez pas d'atteindre un objet qui n'est pas à la portée de main. Si vous devez vous soulever, vous avancer sur votre siège, vous pencher ou vous étirer sur le côté, vers l'avant ou vers l'arrière, vous risquez de faire basculer votre base de positionnement ou de chuter. Ceci augmente considérablement le risque de vous blesser ou d'endommager la base de positionnement.

FRANÇAIS

Transferts

Le passage d'une surface à l'autre doit être effectué de façon sécuritaire, les étapes ci-dessous doivent être suivies afin de minimiser la distance de transfert :

1. Placez la base ainsi que les roues pivotantes avant parallèles à l'objet visé pour le transfert;
2. Assurez-vous que les freins sont engagés afin d'éviter que la base bouge;
3. Retirez ou éloignez les repose-pieds et posez les pieds au sol;
4. Enlevez ou escamotez l'accoudoir et le protège-vêtements sur le côté du transfert;
5. Effectuez le transfert.

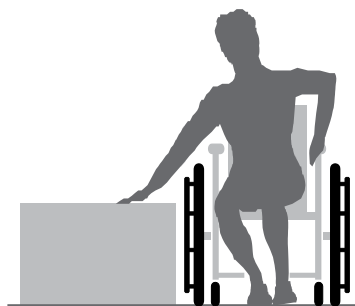

Note – L'utilisation d'une planche de transfert est recommandée pour assurer votre sécurité.



AVERTISSEMENT

- Il n'est pas recommandé d'effectuer un transfert sans l'aide d'un assistant; cela exige un bon équilibre et de l'agilité. Soyez averti qu'il y a un moment où la base de positionnement n'est pas en dessous de vous lorsque vous effectuez un transfert;
- Ne jamais utiliser les palettes des repose-pieds pour se soulever ou effectuer des transferts, ceci risque de faire basculer la base de positionnement vers l'avant, ce qui pourrait provoquer des blessures graves à l'utilisateur/utilisatrice ainsi qu'endommager la base.

Obstacles


- Prenez toujours quelques instants pour vous familiariser à un nouvel environnement et repérer les obstacles susceptibles d'entraver vos mouvements, ceci vous permettra de déterminer les meilleures méthodes pour éviter ou franchir les obstacles de façon sécuritaire;
- Si c'est possible, repensez votre espace de vie et votre lieu de travail. Assurez-vous que votre plancher soit lisse, uniforme et dépourvu d'obstacle et que les passages soient suffisamment larges pour vous permettre de vous déplacer aisément;

- N'utilisez jamais des objets (meubles, poignées, cadrage de porte, etc.) pour vous tirer ou vous propulser avec votre base de positionnement;
- Ne pas tenter d'aborder un obstacle dont la hauteur pourrait mettre en péril la stabilité de la base de positionnement;
- Lorsque vous devez franchir un obstacle, il est recommandé de toujours garder les mains sur les cerceaux de conduite et de vous pencher légèrement vers l'avant lorsque vous montez et légèrement vers l'arrière lorsque vous descendez pour compenser pour le changement du centre d'équilibre;
- Si votre base de positionnement est dotée d'anti-basculants, dégagez-les avant de franchir un obstacle.

Monter un trottoir ou une seule marche

L'assistance d'un accompagnateur est requise afin de monter un trottoir ou une seule marche de façon sécuritaire.

1. L'accompagnateur doit dégager et tourner les anti-basculants vers le haut de façon à éviter qu'ils entrent en conflit avec le palier;
2. Placer la base face au bord du palier;
3. L'utilisateur/l'utilisatrice doit bien appuyer son dos contre le dossier et tenir les accoudoirs;
4. L'accompagnateur doit incliner la base vers l'arrière de façon à élever les roues pivotantes du sol et les déposer sur le palier à gravir;
5. L'accompagnateur doit pousser la base vers l'avant jusqu'à ce que les roues motrices entrent en contact avec le trottoir ou la marche et rouler les roues sur l'obstacle à gravir;
6. Repositionner les anti-basculants pour que les roues pointent vers le bas.

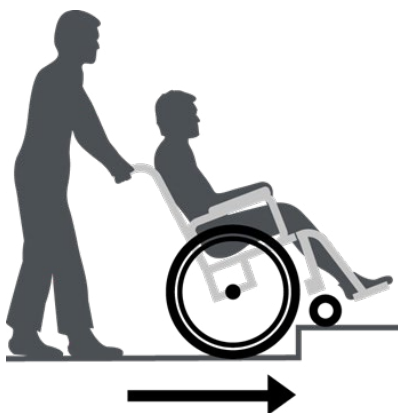

Note – Ne jamais tenter de monter un trottoir ou une marche sans assistance.

FRANÇAIS

Descendre un trottoir ou une seule marche

L'assistance d'un accompagnateur est requise afin de descendre un palier de façon sécuritaire.

1. L'accompagnateur doit tourner les anti-basculants vers le haut de façon à éviter qu'ils entrent en conflit avec le palier et placer la base de dos au bord du celui-ci;
2. L'utilisateur/l'utilisatrice doit bien appuyer son dos contre le dossier et tenir les accoudoirs;
3. L'accompagnateur doit descendre le palier et rouler la base doucement vers lui;
4. Une fois les roues motrices au bas du palier, l'accompagnateur doit, en retenant les deux poignées, incliner la base de façon à élever les roues pivotantes du sol et reculer jusqu'à ce que les roues pivotantes soient dégagées du palier;
5. Repositionner les anti-basculants pour que les roues pointent vers le bas.



Note – Ne jamais tenter de descendre un trottoir ou une marche sans assistance.

Monter et descendre un escalier

L'assistance de deux accompagnateurs est requise afin de monter ou descendre un escalier de façon sécuritaire.

1. Placer l'utilisateur/l'utilisatrice dos à l'escalier. Le premier accompagnateur doit se positionner derrière la base de positionnement et le retenir par les poignées. Le second accompagnateur doit se tenir face à l'utilisateur/l'utilisatrice et maintenir une partie fixe du châssis à l'avant de la base;
2. Une fois que les deux accompagnateurs sont en position, incliner la base de positionnement de façon à élever les roues pivotantes du sol;



Note – N'oubliez pas de garder votre dos droit et de fléchir vos genoux pour soulever la base.

3. Avancer la base de positionnement jusqu'à ce que les roues motrices soient près de la première marche et soulever la base;
4. Monter ou descendre l'escalier et déposer la base doucement sur le palier;
5. Repositionner les anti-basculants pour que les roues pointent vers le bas.

Escaliers roulants

Ne tentez jamais d'utiliser votre base de positionnement sur un escalier roulant, même avec un accompagnateur. Vous risquez de perdre le contrôle de votre base et de chuter, risquant ainsi de provoquer des blessures graves à vous-même ou à d'autres personnes ainsi que d'endommager votre base de positionnement.

Centre d'équilibre

Le centre d'équilibre peut être modifié par divers facteurs. Procédez avec précaution lorsque :

- La base de positionnement est inclinée. Le centre d'équilibre est affecté lorsque vous montez ou descendez une pente ou un obstacle (ex. trottoir, escalier);
- Un changement dans la posture et/ou la distribution du poids de l'utilisateur, peut modifier le centre d'équilibre;
- Ne jamais fixer d'autres objets au dossier que ceux fournis avec la base de positionnement, ceci affectera le centre d'équilibre de la base.

Monter et descendre une pente ou une rampe

Certaines précautions sont nécessaires lorsque vous montez ou descendez une pente ou une rampe ou si vous êtes en présence d'une surface dénivelée :

- Ne descendez/montez jamais une pente ou une surface qui présente un dénivellement de plus de 10% (10% correspond à une élévation de 1 mètre pour une distance de 10 mètres);
- Vérifiez l'endroit et repérez les obstacles et/ou les changements d'inclinaison pour éviter tout danger;
- Prenez garde aux surfaces mouillées ou glissantes;
- Toujours avoir un accompagnateur derrière votre base de positionnement lorsque vous vous engagez sur une longue pente;

FRANÇAIS


- Toujours garder les mains sur les cerceaux de conduite pour assurer une vitesse de descente contrôlée;
- N'effectuez pas de changement de direction lorsque vous vous trouvez sur une pente ou une rampe;
- Le déplacement en pente affecte le centre d'équilibre de votre base de positionnement et augmente le risque de basculement ou de chute vers l'arrière, sur le côté ou vers l'avant. Pour maintenir une bonne stabilité et demeurer en équilibre sur une pente, il est important d'adapter la position de son corps;
- N'arrêtez pas votre base de positionnement sur une pente raide;
- N'utilisez pas les freins de stationnement pour vous ralentir ou vous immobiliser;
- Lorsque vous vous engagez sur une rampe d'accès, assurez-vous que votre base de positionnement est bien centrée et que les roues demeurent toujours à l'intérieur de celle-ci.

**AVERTISSEMENT**

- Assurez-vous que les rampes utilisées sont conformes aux normes légales de votre région;
- Le changement d'inclinaison affecte l'efficacité des anti-basculants, il se peut que ceux-ci ne puissent pas empêcher un basculement ou une chute vers l'arrière, si vous n'adaptez pas votre position pour contrer le changement du centre d'équilibre.

Descendre une pente ou une rampe

1. Penchez votre corps vers l'arrière, ceci vous permettra de vous adapter au changement du centre d'équilibre causé par la surface inclinée;
2. Laissez les cerceaux de conduite glisser dans vos mains tranquillement afin de contrôler vitesse de descente;
3. Lors de la descente, déplacez-vous en ligne droite et assurez-vous de bien contrôler la direction de la base de positionnement.

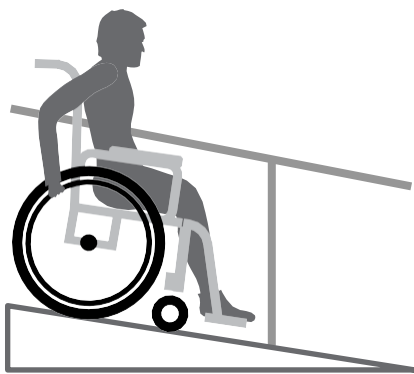

Descendre une pente

Monter une pente ou une rampe

1. Penchez votre corps vers l'avant, ceci vous permettra de vous adapter au changement du centre d'équilibre causé par la surface inclinée;
2. Effectuez une propulsion ferme et vigoureuse sur les deux cerceaux de conduite.



Monter une pente

Déplacement à reculons

La prudence est de mise lorsque vous vous déplacez à reculons. La base de positionnement est conçue pour offrir une meilleure stabilité lors des déplacements vers l'avant. Pour vous déplacer sécuritairement à reculons, assurez-vous que la voie est libre et déplacez-vous lentement, sans mouvement brusque.

Cabrage

Le cabrage en base de positionnement est une manœuvre dangereuse qui peut entraîner une perte de contrôle, un basculement ou une chute, et peut endommager la base de positionnement et/ou blesser l'utilisateur/l'utilisatrice ou d'autres personnes.

- Consultez votre ergothérapeute pour savoir si vous avez les aptitudes physiques requises pour apprendre à effectuer un cabrage de façon sécuritaire;
- Ne pas tenter de basculer la base de positionnement sans assistance.

FRANÇAIS

4. Instructions

Outils nécessaires

Nos bases de positionnement sont conçues pour être facile à ajuster et à entretenir avec des outils à main standards.

Vous aurez besoin des outils suivants :

- Clés métriques : 4 mm, 8 mm, deux clés de 10 mm, deux clés de 13mm et 19 mm
- Clés Allen métriques : 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 10 mm
- Clés impériales : 7/16" et 3/4", 1 1/8"
- Clés Allen : 7/64", 1/4", 7/16"
- Deux clés à douille de 3/4"
- Clé à cliquet de 19 mm
- Tournevis Phillips (étoile)



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser des outils pneumatiques ou électriques, ceci pourrait endommager la base de positionnement.



AVERTISSEMENT

- Toute modification apportée à votre base de positionnement doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des utilisateurs/utilisatrices et des individus mis en contact avec la base de positionnement.
- Attention de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous installez un composant de la base de positionnement ou utilisez une pièce amovible.

Hauteur siège/sol

Il est important de noter que la hauteur siège/sol de la base Neox^{MC} Dynamic varie en fonction de la position et des diamètres des roues pivotantes et des roues motrices. Les autres hauteurs disponibles s'obtiennent au moyen d'ajustement sur le châssis.

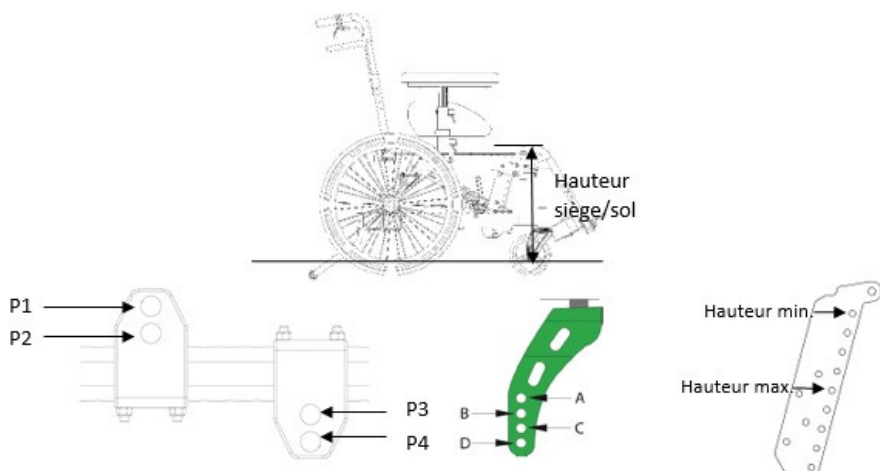


Tableau de configuration 4 roues

Roues motrices	Roues pivotantes	Position roues motrices	Position roues pivotantes	Hauteur siège/sol (Ajustement des plaques du châssis)
12" (305 mm)	5" (130 mm)	P3	D	13" à 17" (330 à 430 mm)
	6" (150 mm)	P3	C	14" à 18" (360 à 460 mm)
	8" (200 mm)	P4	D	15" à 19" (380 à 480 mm)
20" (508 mm)	5" (130 mm)	P1	C	13" à 17" (330 à 430 mm)
	6" (150 mm)	P1	B	13" à 17" (330 à 430 mm)
	6" (150 mm)	P2	D	14" à 18" (360 à 460 mm)
	D6" (150 mm)	P2	B	14" à 18" (360 à 460 mm)
22" (559 mm)	6" (150 mm)	P1	D	14" à 18" (360 à 460 mm)
	D6" (150 mm)	P1	B	14" à 18" (360 à 460 mm)
	8" (200 mm)	P2	D	15" à 19" (380 à 480 mm)
24" (610 mm)	D6" (150 mm)	P1	D	15" à 19" (380 à 480 mm)
	8" (200 mm)	P1	D	15" à 19" (380 à 480 mm)



Note – La hauteur siège/sol peut être limitée de 13", 14" ou 15" selon la grandeur de roue motrice choisie.

Tableau de configuration 6 roues			
Roues motrices	Hauteur siège/sol	Position requise	
		P1	P2
20" (510 mm)	13" à 17" (330 à 430 mm)	X	
22" (560 mm)	14" à 18" (360 à 460 mm)	X	
24" (610 mm)	15" à 19" (380 à 480 mm)	X	

Note -Il n'y a que les roues motrices à choisir selon la hauteur siège/sol désirée. Les autres roues sont fournies assemblées à des fourches dynamiques ayant un diamètre de 5" (127 mm), 6" (152 mm).

Modifier la position du bloc d'ancrage des roues motrices

1. Enlevez les roues motrices en vous référant à la section *Désinstaller l'essieu fileté* ou *Désinstaller l'essieu à dégagement rapide*, selon le type d'essieu;
2. Dévissez les écrous **A** à l'aide d'une clé de 13 mm et retirez les vis **B**;
3. Avancez ou reculez et orientez le bloc d'ancrage **C** de façon à obtenir l'emplacement et l'orientation désiré;
4. Remettez les vis **B** dans le bloc et vissez les écrous **A**;
5. Réinstallez les roues motrices à la position voulue en vous référant au Tableau de hauteur siège/sol correspondant à la configuration de votre base de positionnement.

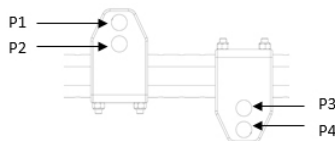


**AVERTISSEMENT**

- En modifiant la position des roues motrices sur le bloc d'ancrage, il est possible que vous ayez à changer l'emplacement des roues pivotantes ou que vous ayez à changer le diamètre de celles-ci.
- Toujours utiliser les roues motrices dans la position la plus reculée possible pour garantir le maximum de stabilité et s'assurer que l'espace devant les roues motrices est suffisante pour l'installation du frein de stationnement.

Modifier la position des roues pivotantes

Cette opération vous permettra d'ajuster la hauteur siège/sol des roues pivotantes.

1. Dévissez la vis **A** à l'aide de deux clés de 13 mm, et retirez les espaceurs, s'il y a lieu;
2. En vous référant au Tableau de hauteur siège/sol correspondant à votre fauteuil, ci-dessus, déterminez la position adéquate pour obtenir la hauteur siège/sol désirée;
3. Positionnez la roue pivotante vis-à-vis le trou d'ajustement approprié;
4. Remettez les espaceurs, s'il y a lieu, et resserrez la vis **A**.

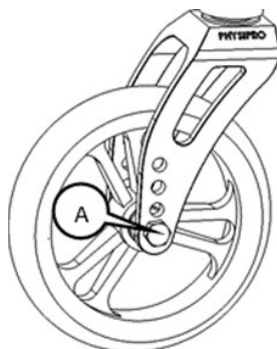

Note - Une fois la vis installée, la roue doit tourner aisément.

FRANÇAIS


Roues motrices

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic peut être équipée de roues motrices de propulsion de différents formats allant de 12" à 24" (310 à 610 mm). Il est possible de les ajuster en hauteur à 4 positions différentes.

Note – Afin de simplifier la procédure d'installation ou d'ajustement, placez la base de positionnement sur une surface plane telle qu'une table ou un établi.


Installer les roues motrices avec l'essieu fileté

1. Assurez-vous que le bloc d'ancrage est bien positionné, sinon référez-vous à la section *Modifier la position du mécanisme d'ancrage*;
2. Positionnez la douille d'essieu **E** dans le trou correspondant à la hauteur désirée du bloc d'ancrage **F**.
3. Fixez le tout en place avec la rondelle de blocage **D** et l'écrou **C** à l'aide d'une clé 1 $\frac{1}{8}$ ";
4. Insérez l'essieu **A** dans le moyeu de la roue **B** et la douille d'essieu **E**;
5. Vissez l'écrou **G** avec une clé de $\frac{3}{4}$ " tout en maintenant l'essieu **A** avec une clé à douille $\frac{3}{4}$ ".

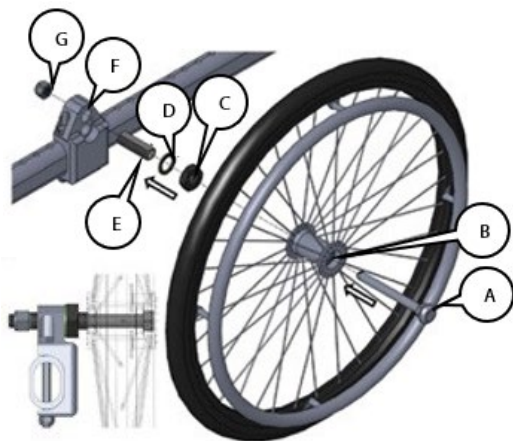

Désinstaller l'essieu fileté

1. Desserrez l'écrou **C** avec une clé de $\frac{3}{4}$ " tout en maintenant l'essieu **A** avec une autre clé à douille $\frac{3}{4}$ ";
2. Retirez l'écrou **C**;
3. Faites glisser l'essieu **A** à l'extérieur de la douille d'essieu **B**;
4. Retirez l'essieu **A** et la roue.

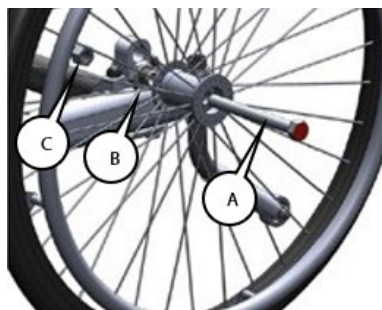


**AVERTISSEMENT**

• Lorsque vous ajustez ou réinstallez les roues, vérifiez systématiquement la stabilité de la base de positionnement. L'ajustement des roues pivotantes, des freins, des anti-basculants, des blocs d'ancrage, des roues motrices, ainsi qu'un changement d'emplacement de l'assise et du dossier peut s'avérer nécessaire. Ces ajustements doivent être effectués par un technicien qualifié.

Installer les roues motrices avec l'essieu à dégagement rapide


1. Assurez-vous que le bloc d'ancrage est bien positionné, sinon référez-vous à la section *Modifier la position du mécanisme d'ancrage*;
2. Positionnez la douille d'essieu **E** dans le trou correspondant à la hauteur désirée du bloc d'ancrage **F**.
3. Fixez le tout en place avec la rondelle de blocage **D** et de l'écrou **C** à l'aide d'une clé 1 1/8";
4. Insérez l'essieu **A** dans le moyeu de la roue **B** et la douille d'essieu **E**.

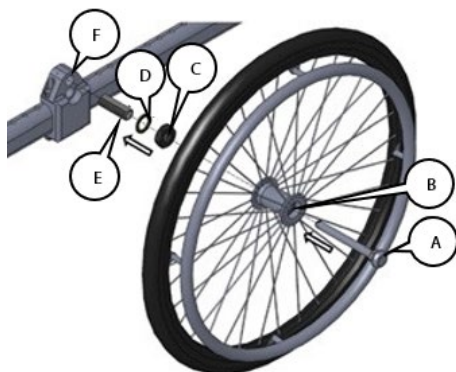**Désinstaller l'essieu à dégagement rapide**

1. Dévissez l'écrou **C** et retirez la rondelle de blocage **D**;
2. Retirez l'essieu **A** du moyeu de la roue **B** et de la douille d'essieu **E**.

Ajuster l'essieu à dégagement rapide

Si les roues motrices ne tournent pas librement ou qu'un jeu anormal est observé, vous devez procéder à l'ajustement de l'essieu à dégagement rapide. Au besoin, vissez ou dévissez l'écrou de l'essieu amovible **C** avec une clé 3/4" tout en maintenant l'autre bout de l'essieu avec une clé 7/16". Assurez-vous que les billes de blocage **A** sont bien relâchées et dépassent complètement la douille d'essieu **B**.

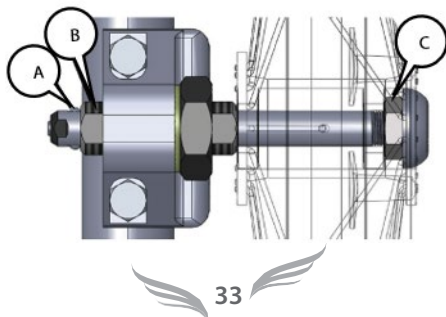


FRANÇAIS

Utiliser le système d'essieu à dégagement rapide

L'essieu à dégagement rapide est une option offerte sur la base Neox^{MC} Dynamic. Si cette option a été sélectionnée, il vous sera possible d'enlever les roues en trois étapes simples :

1. Libérez le frein en tirant vers l'arrière ou en poussant vers l'avant, selon votre type de freins;
2. Appuyez sur le bouton **D** au centre de la roue;
3. Sans relâchez le bouton **D**, tirer la roue vers l'extérieur.

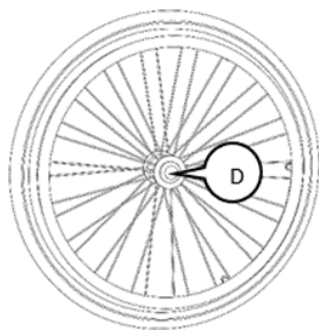

Pour réinstaller la roue, appuyez sur le bouton **D**, sans le relâchez, et réinsérer l'essieu.

Note - Assurez-vous que les billes de blocage sont bien relâchées et que la tête de la goupille de blocage à bille est alignée avec le bout de l'essieu avant de circuler avec le fauteuil.

**AVERTISSEMENT**


- Lorsque vous ajustez ou réinstallez les roues, assurez-vous que les billes de blocage sont bien relâchées et que la tête de la goupille de blocage à bille est alignée avec le bout de l'essieu avant de circuler avec la base.
- Maintenez l'essieu amovible propre et exempt de poussière ou mousse pour assurer son bon fonctionnement. Lubrifiez si nécessaire.
- Assurez-vous toujours que les deux roues motrices sont bien verrouillées avant l'utilisation de la base de positionnement. Un dégagement rapide non verrouillé peut se détacher lors de l'utilisation et causer une chute.

Déplacement horizontal des roues motrices

L'emplacement horizontal des roues motrices a une influence considérable sur la stabilité de la base de positionnement. Plus on positionne les roues vers l'avant, plus la stabilité en bascule est diminuée. Par le fait même, plus les roues sont vers l'avant, plus la propulsion est facilitée. Donc, pour satisfaire le besoin de chaque client, il est possible d'effectuer différents ajustements horizontaux.

Voici les étapes à suivre pour effectuer ce déplacement :

1. Enlevez la roue motrice en vous référant à la section *Désinstaller l'essieu fileté* ou *Désinstaller l'essieu à dégagement rapide*, selon votre type d'essieu;
2. Dévissez les écrous **A** à l'aide d'une clé de 13 mm et retirez les vis **B**;
3. Avancez ou reculez le bloc d'ancrage **C** de façon à obtenir l'emplacement désiré;
4. Remettez les vis **B** dans le bloc et vissez les écrous **A**.





AVERTISSEMENT

- Toujours utiliser les roues motrices dans la position la plus reculée possible pour garantir le maximum de stabilité et s'assurer que l'espace devant les roues motrices est suffisante pour l'installation du frein de stationnement.

Déplacement latéral des roues motrices

Cette modification sert à rapprocher ou à éloigner les roues motrices du châssis. Les étapes à effectuer sont les suivantes :

1. Enlevez la roue motrice en vous référant à la section *Désinstaller l'essieu fileté* ou *Désinstaller l'essieu à dégagement rapide*, selon votre type d'essieu;
2. À l'aide d'une clé de 1 1/8", desserrez l'écrou **A** pour pouvoir libérer la douille d'essieu **B**;
3. Dévissez ou vissez la douille d'essieu **B** vers l'intérieur ou vers l'extérieur afin d'avoir l'emplacement voulu;
4. Resserrez l'écrou **A** fermement avec la clé de 1 1/8";
5. Réinstallez la roue motrice.



AVERTISSEMENT

- Après tout réglage, assurez-vous que l'ensemble du matériel de fixation est bien serré - sinon des blessures ou des dommages pourraient survenir.

FRANÇAIS

Pneus à pression (option)

Si votre base de positionnement est équipée de pneus à pression, suivez les indications suivantes pour installer les chambres à air et gonfler les pneus de façon sécuritaire.

Installer la chambre à air

1. Avant l'installation de chambres à air, assurez-vous que les jantes et l'intérieur des pneus soient propres;
2. Pré-gonflez légèrement la chambre à air;
3. Positionnez la valve dans le trou de valve de la jante;
4. Placez l'intégralité de la chambre à air dans le pneu;
5. Bien positionner le pneu dans la jante, assurez-vous de ne pas coincer la chambre à air.



Gonfler les pneus

1. Repérez la pression maximale indiquée sur le flanc du pneu;
2. Repérez la valve;
3. Gonflez à l'aide d'une pompe à vélo avec manomètre, jusqu'à atteindre la pression indiquée.



Note - La pression des pneus peut varier d'un fabricant à l'autre, toujours vérifier l'unité de mesure de la pression d'air indiqué sur le flanc du pneu.



AVERTISSEMENT


- Ne jamais circuler sans une pression adéquate des pneus (dans le cas de roues à chambres à air), la pression recommandée des pneus est indiquée sur ces derniers.
- Une vérification de la pression de vos pneus à toutes les semaines est recommandée, tel qu'indiqué dans la section *Liste de vérification*.
- Les pneus risquent d'éclater s'ils sont surgonflés, alors que s'ils sont sous-gonflés, ils peuvent se déformer. La déformation du pneu peut provoquer un glissement du frein et faire tourner la roue de façon inattendue, occasionnant possiblement une perte de contrôle de la base de positionnement.
- Un gonflement adéquat des pneus permet de prolonger la durée de vie des pneus et de faciliter l'utilisation de la base de positionnement.

Fourches escamotable (option 6 roues)

Le mécanisme de fourche escamotable facilite le déplacement au quotidien. Par un simple mouvement de pied, les roues arrière se dégagent pour surmonter les obstacles.

Installer le mécanisme de fourcheescamotable

1. Insérez la courroie **A** dans la bague de serrage **B**;
2. Insérez la courroie dans l'œillet **C**;
3. Rabattez la courroie sur elle-même et ajustez la tension de celle-ci;
4. Positionnez la bague de serrage **B** sur la courroie superposée;
5. Serrez la vis **D** avec une clé Allen de 3mm.

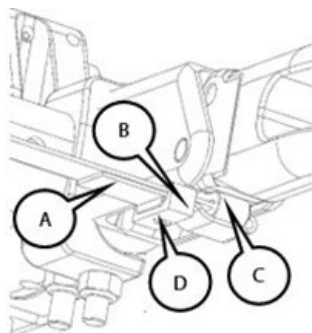


Franchir des obstacles – Mécanisme de fourche escamotable



AVERTISSEMENT

Pour une question de sécurité, il est important de remettre l'assise parallèle au sol et de retenir le poids de l'occupant avant d'utiliser le mécanisme de fourche escamotable pour franchir un obstacle.

1. Avancez la base de positionnement le plus près possible de l'obstacle à franchir;
2. Levez les poignées **A** afin de retirer le poids de l'occupant des roues arrière;

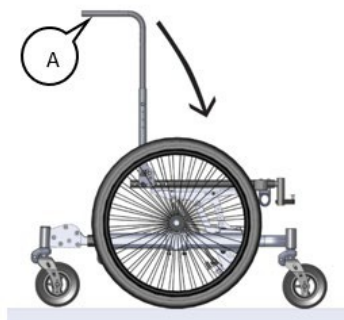


FRANÇAIS

- Une fois les roues arrière libres, appuyez doucement sur la sangle **B** pour retirer les plongeurs dumécanisme;

**AVERTISSEMENT**

Les roues pivotantes ne devraient plus toucher le sol.

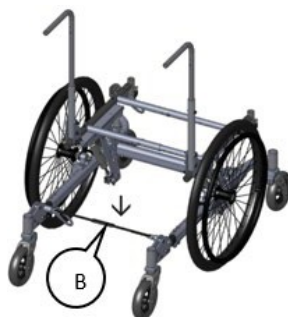

- En gardant le pied sur la sangle au départ, basculez la base de positionnement vers l'arrière et poussez la base de positionnement vers l'avant jusqu'à ce que les roues pivotantes franchissent l'obstacle.

**AVERTISSEMENT**

L'obstacle maximum franchissable est d'environ 5 pouces (127 mm).




Roues pivotantes

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic peut accueillir des roues pivotantes avant en polyuréthane de 5" (127 mm), 6" (152 mm), 7" (178 mm) et 8" (203 mm) de diamètre avec une largeur de 1" (25 mm), 1 ¼" (32 mm) ou 1 ½" (38 mm) ou des pneus à pression de 6" ou 8" (150 ou 200 mm) de diamètre avec une largeur de 1 ¼" (32 mm).

Assembler et installer la fourche

Les fourches peuvent être changées en utilisant la procédure qui suit :

1. Insérez l'espaceur **A** sur le boulon **B**;
2. Glissez le boulon **B** avec l'espaceur **A** dans la fourche **C**;
3. Enlevez le capuchon sur le support de fourche;
4. Insérez les espaceurs **D** et l'écrou **E** sur le boulon **B**;
5. Insérez le boulon **B** à l'intérieur du support de fourche;
6. Fixez la fourche en vissant l'écrou **E** sur le boulon **B** avec une clé à cliquet réversible de 19 mm, en utilisant une clé de 19 mm pour maintenir le boulon **B**;
7. Posez le capuchon sur le support de fourche.

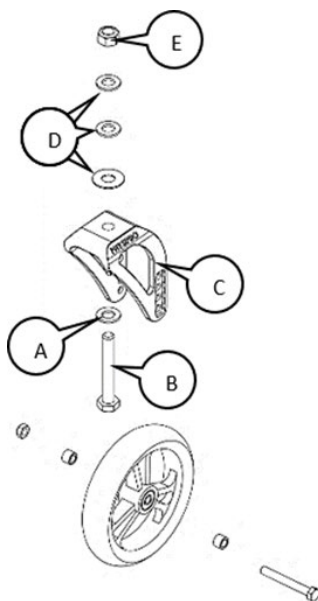


Note - Assurez-vous que les fourches sont solidement fixées et que celles-ci tournent aisément. Dans le cas contraire, desserrez légèrement l'écrou **B**.

FRANÇAIS

Installer les roues pivotantes

1. Déterminez la position de la roue pivotante sur la fourche, se référer à la section *Hauteur siège/sol*;
2. Insérez la vis **A** dans le trou correspondant à votre choix en prenant soin d'installer les deux rondelles d'espacement **B** entre la roue et la fourche;
3. Mettez l'écrou **C** au bout de la vis **A** et resserrez à l'aide de deux clés de 13 mm.

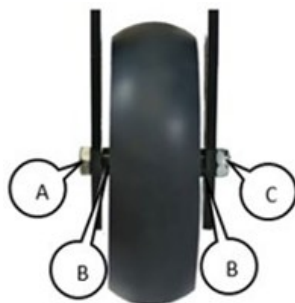

Note - Une fois le tout resserré, la roue doit tourner aisément.

**AVERTISSEMENT**

- Le changement de roues pivotantes pour des roues d'une largeur différente peut nécessiter l'acquisition d'une fourche adaptée.
- Toute modification apportée à votre base de positionnement doit être réalisée par un professionnel. Le non-respect de cet avis peut entraîner de lourdes conséquences au niveau de la sécurité des utilisateurs/utilisatrices et des individus mis en contact avec la base de positionnement.
- Ne jamais circuler sans une pression adéquate des pneus (dans le cas de roues à chambres à air), la pression recommandée des pneus est indiquée sur ces derniers. Une vérification de la pression de vos pneus à toutes les semaines est recommandée, tel qu'indiqué dans la section Liste de vérification. Les pneus risquent d'éclater s'ils sont surgonflés, alors que s'ils sont sous-gonflés, ils peuvent se déformer. La déformation du pneu peut provoquer un glissement du frein et faire tourner la roue de façon inattendue, occasionnant possiblement une perte de contrôle de la base de positionnement. Un gonflement adéquat des pneus permet de prolonger la durée de vie des pneus et de faciliter l'utilisation de la base de positionnement.




Siège

Modifier la profondeur de siège

La profondeur de siège de la base Neox^{MC} Dynamic peut être modifiée par le déplacement des tubes intérieurs du châssis.


Voici les étapes à suivre pour modifier la profondeur du siège:

1. Dans un premier temps, dévissez les boulons **A** avec une clé Allen 5 mm et une clé 10 mm et les boulons **B** avec une clé Allen 3 mm et une clé 8 mm pour retirer les deux plaques d'assise.
2. Ensuite, dévissez et retirez les boulons **C** avec une clé Allen 5 mm et une clé 10 mm dans la section avant du siège;
3. Glissez le longeron **D** dans le **E** afin d'obtenir la profondeur désirée. Du même coup, vous pouvez ajuster la profondeur des repose-pieds;
4. Insérez les boulons **C** dans les trous d'ajustement appropriés et vissez fermement;
5. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm et d'une clé de 10 mm, dévissez les boulons **F** de la section arrière du siège;
6. À l'aide d'un chasse-goupille, retirez les bagues d'alignement **G**;

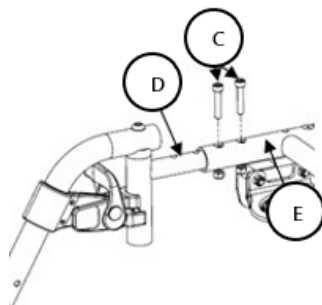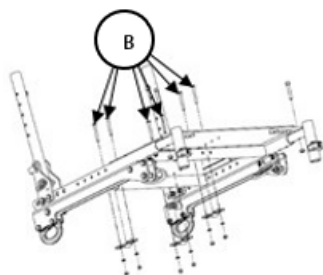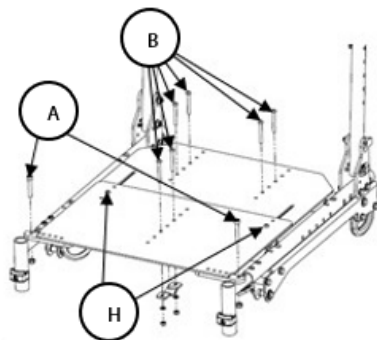

FRANÇAIS

7. Avancez ou reculez les montants de dossier de façon à obtenir la profondeur désirée;
8. Remettez les bagues d'alignement **G** et les boulons **F** et resserrez le tout;
9. Desserrez les vis **H** avec une clé Allen 3 mm et une clé 8mm, ajustez les deux plaques d'assise de la profondeur désirée et insérez les vis **A** et **B** dans les trous d'ajustements appropriés;
10. Resserrez les vis **H** et vissez fermement les vis **A** et **B**.

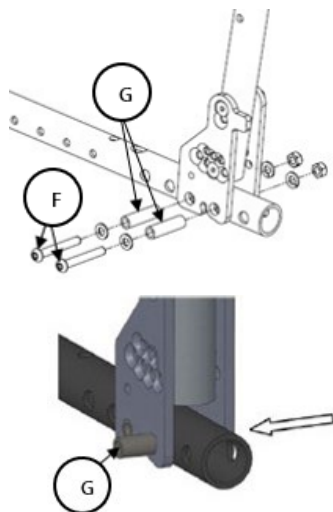

Pour toutes les profondeurs d'assise commandées, il est possible d'augmenter ou de diminuer la profondeur de 1" (25 mm).

Modifier la largeur de siège (Option)

La largeur de siège de la base de positionnement Neox^{MC} Dynamic peut être modifiée selon le châssis choisi.

Les trois grandeurs de châssis disponibles offrent les plages d'ajustement suivantes par incrément de 1" :



Châssis standard : 14" à 22" (356 à 559 mm)

Châssis large : 19" à 22" (482 à 559 mm)

Châssis renforcé : 19" à 26" (482 à 660 mm)

1. Dévissez les boulons **A** avec une clé Allen de 3 mm et une clé de 8 mm et retirez le siège rigide **B**;
2. Dévissez les boulons **C** des traverses ajustables avec deux clés de 13mm;
3. Dévissez les deux vis **D** du châssis ajustable avec deux clés de 10mm
4. Dévissez les deux vis centrales de la barre de tension de dossier, avec une clé Allen de 3mm;

5. S'il y a lieu, dévissez les deux vis centrales de la poignée de poussée, avec une clé Allen de 4mm;
6. Élargissez ou rétrécissez simultanément les traverses ajustables, le châssis ajustable, la barre de tension et la poignée de poussée, s'il y a lieu, à la position désirée.
7. Réinsérez les boulons **C** et **D**, les vis de la barre de tension et, s'il y a lieu, les vis de la poignée de poussée;
8. Repositionnez le siège rigide **B** et réinsérez les boulons **A**.
9. Serrez fermement les boulons **A**, **C** et **D**, les vis de la barre de tension et les vis de la poignée de poussée s'il y a lieu.

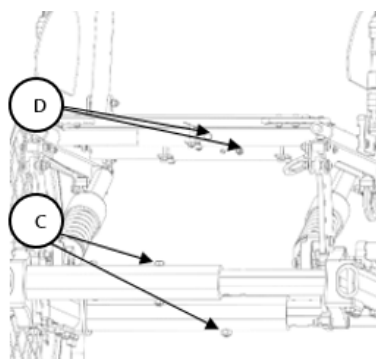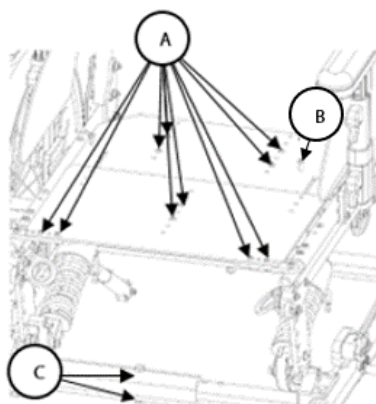


Note - La barre de tension, la poignée de poussée et le siège rigide peuvent limiter la plage d'ajustement.

Ceinture pelvienne de positionnement

La ceinture pelvienne de positionnement a pour fonction primaire de maintenir une bonne posture et de sécuriser l'utilisateur/l'utilisatrice dans la base de positionnement.


Installer la ceinture pelvienne de positionnement

Positionnez la plaque d'ancrage de la ceinture **A** sur le longeron et serrez la vis **B** avec une clé Allen de 4 mm.

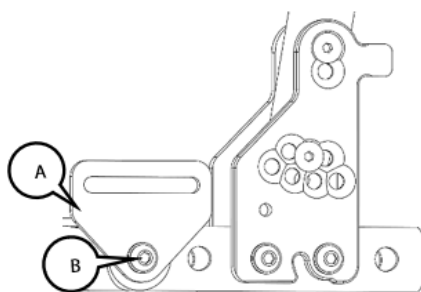

FRANÇAIS

Pour ajuster la longueur de la ceinture, vous devez faire coulisser la courroie **C** dans la boucle de plastique **D** de façon à allonger ou à raccourcir la ceinture.

**AVERTISSEMENT**

- Il est important de toujours porter votre ceinture de positionnement.
- Une utilisation inadéquate peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Dossier

Les montants réglables sont disponibles pour chaque dossier : standard, dynamique ou inclinable.


Les montants sont ajustables par incrément de 1", le tableau suivant indique la plage d'ajustement des montants selon le type de dossier installé.

Montant dossier standard	Montant dossier dynamique	Montant dossier inclinable
16" à 20" (406 à 508 mm)	18" à 22" (457 à 559 mm)	16" à 20" (406 à 508 mm)
21" à 25" (533 à 635 mm)	23" à 27" (584 à 686 mm)	21" à 25" (533 à 635 mm)

Modifier la hauteur des montants de dossier

L'étape suivante vous permet de modifier la hauteur des montants ou changer de modèle de montant.

1. Enlevez la vis **A** et la rondelle de blocage **B** à l'aide d'une clé de 10 mm;
2. Montez ou descendez la partie amovible du montant pour obtenir la hauteur désirée ou remplacez l'ancien montant par le nouveau modèle;
3. Remettez la vis **A** et la rondelle de blocage **B**, resserrez le tout.




Dossier standard

Modifier l'angle de dossier standard

L'angle de dossier peut être ajusté selon les besoins du client. Pour ce faire, vous devez :

1. Retirer les écrous et les rondelles des vis **B** avec une clé de 10 mm et une clé Allen de 4 mm;
2. Une fois les vis retirées, changer l'angle de dossier selon les besoins de votre client;
3. Repositionner les vis **B** dans le trou correspondant à l'angle choisi et resserrer le tout.

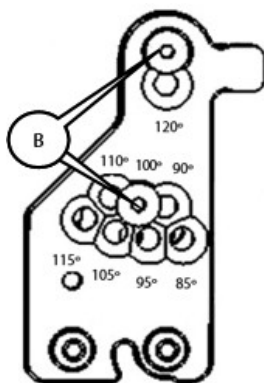



Note - L'intervalle entre deux positions consécutives est de 5°. Pour un angle de 120°, il faut utiliser la position 115° en combinaison avec le trou supérieur 120°. L'angle de 120° est atteignable avec les montants de dossier standards seulement.

Retirer le dossier standard

Le dossier standard peut être retiré et remplacé par un dossier dynamique ou un dossier inclinable par vérin, selon le besoin de l'utilisateur.

Voici les étapes à suivre pour retirer les montants de dossier standard :

1. Retirez les accoudoirs et les roues motrices; Enlevez le câble et les poignées d'activation du système de bascule;
2. Retirez le dossier, la barre de tension et les poignées de poussée, s'il y a lieu;
3. Enlevez les montants de dossier en dévissant le boulon **A** avec une clé de 10 mm;

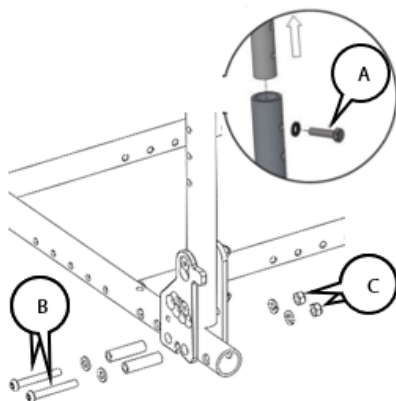

FRANÇAIS

4. Dévissez les deux boulons **B** et les écrous **C** avec deux clés de 10 mm et retirez la plaque de positionnement standard;

Note - Si les plaques ne se délogent pas, enlevez les deux douilles **D** situées dans le longeron, avec un poinçon plat, afin de les retirer plus facilement. Réinstallez les deux douilles dans le longeron.

Dossier dynamique

Installer le dossier dynamique


1. Retirez le dossier standard (voir section *Retirer le dossier standard*)

2. Au besoin, réinstallez les douilles **A** dans le longeron;

3. Installez les plaques de positionnement pour dossier dynamique et l'ancrage de montant dynamique;

Note - La tension du dossier dynamique doit être relâchée pour permettre l'ajustement en angle.

4. Fixez le tout en vissant les boulons **B** avec les rondelles **C** et les écrous **D** avec deux clés de 10 mm;

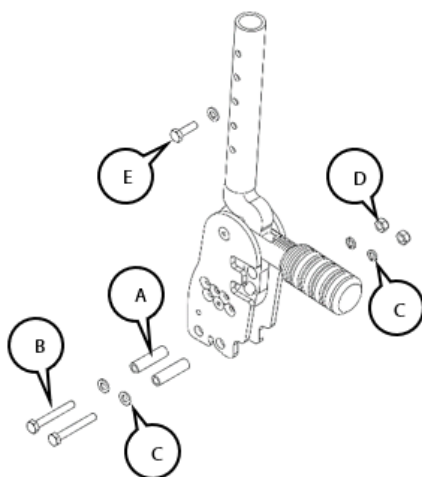


5. Réinstallez les montants de dossier et ajustez leur hauteur en insérant la vis **E** avec une clé de 10 mm;
6. Réinstallez le dossier, la barre de tension, ainsi que les poignées de poussée, s'il ya lieu;
7. Réinstallez les accoudoirs et les roues motrices;
8. Installez les poignées d'activation et placez le câble.

Modifier l'angle du dossier dynamique

L'angle de dossier dynamique peut être ajusté selon les besoins du client.


Pour ce faire, vous devez :

1. Tourner la poignée de tension du dossier dynamique pour diminuer la tension;
2. Retirer le boulon inférieur **D** avec une clé Allen de 4 mm et une clé de 10 mm;
3. Une fois les vis retirées, changer l'angle de dossier selon les besoins de votre client;
4. Repositionner le boulon **D** dans le trou correspondant à l'angle choisi et resserrer le tout;
5. Régler la tension du dossier dynamique.

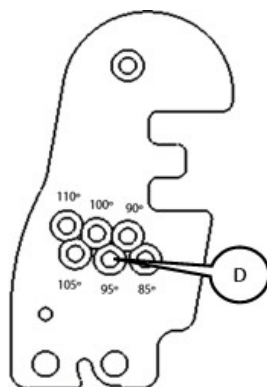

Régler la tension du dossier dynamique

- Pour diminuer la tension, tournez la poignée **F** vers la gauche (sens antihoraire).
- Pour augmenter la tension, tournez la poignée **F** vers la droite (sens horaire).




FRANÇAIS



Dossier inclinable par vérin

Le mécanisme d'inclinaison par vérin est préassemblé. Les étapes suivantes sont nécessaires pour vous permettre de changer un dossier standard pour un dossier inclinable par vérin.



Note - le mécanisme d'inclinaison par vérin ne peut pas être installé avec des montants de dossier dynamique.

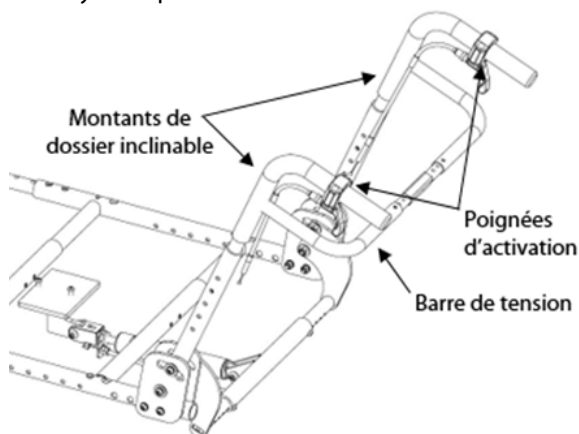**Installer le mécanisme d'inclinaison par vérin**

1. Retirez complètement la quincaillerie des montants de dossier standard (voir la section *Retirer le dossier standard*);
2. Dévissez complètement les vis **A** avec une clé Allen de 5mm et coulissez la traverse interne dans la traverse externe jusqu'à la largeur désirée;
3. Placez les espaceurs inférieurs **B** dans les trous des longerons, à la profondeur de siège désirée;
4. Placez les espaceurs supérieurs **C** dans les trous des ancrages des montants et placez ceux-ci entre les deux plaques de positionnement;
5. Placez les plaques de positionnement tel qu'illustré;

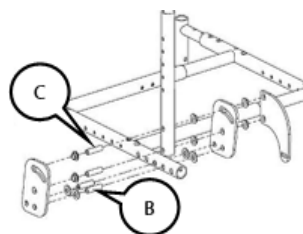

6. Insérez les vis **D** avec leurs rondelles à travers les plaques de positionnement et les longerons et fixez le tout avec une clé Allen 5 mm;
7. Insérez les vis **E** à travers les plaques de positionnement et l'ancrage des montants, en vous assurant que toute la quincaillerie d'assemblage ainsi que la plaque de pivot **F** soient bien positionnées; Fixez le tout avec une clé Allen de 5 mm;
8. Réinsérez la vis **A** dans les traverses internes et externes et resserrez celle-ci;
9. Au besoin, percez des trous de 5 mm dans la plaque d'ancrage
10. Fixez la plaque d'ancrage du cylindre **G** sur le siège rigide avec les vis **H** et resserrez le tout avec une clé Allen de 4mm;
11. Réinstallez les montants de dossier et ajustez leur hauteur;
12. Réinstallez le dossier, la barre de tension et la poignée de poussée, s'il y a lieu;
13. Installez la poignée d'activation (voir section Installer la poignée d'activation) et vissez le câble;
14. Réinstallez les accoudoirs et les roues motrices.

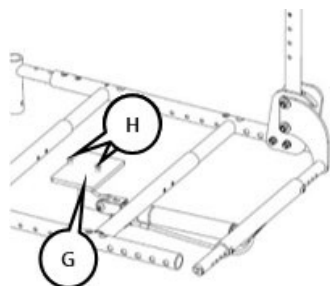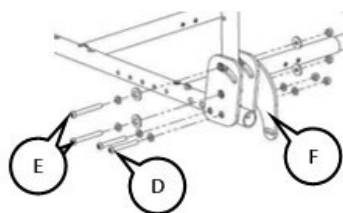

Note- En installant un dossier inclinable à vérin, vous devez changer une des poignées d'activation de la bascule d'origine pour un modèle muni d'un câble répartiteur.


Modifier l'angle du dossier inclinable

1. Pour incliner le dossier, appuyez sur la poignée d'activation;
2. Ajustez l'angle de dossier tel que désiré;
3. Relâchez la poignée d'activation pour verrouiller en place.

FRANÇAIS

Installer la barre de tension


1. Dévissez complètement les vis **A**;
2. Insérez la partie **B** sur la tige **C**;
3. Insérez les vis **D** dans le trou pré-percé du montant de dossier et l'embout de la barre de tension et resserrez avec une clé Allen de 4mm;
4. Fixez la largeur de la barre de tension et resserrez les vis **A** avec une clé Allen de 3mm.

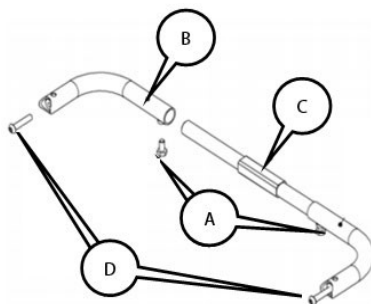

Pour retirer la barre de tension, dévissez complètement les vis **D**.

Installer le support d'appui-tête sur la barre de tension



1. Positionnez les deux parties **E** et **F** du bloc de support d'appui-tête sur la partie **C** de la barre de tension;
2. Fixez en place en vissant les 4 vis **G** avec une clé Allen de 5 mm.

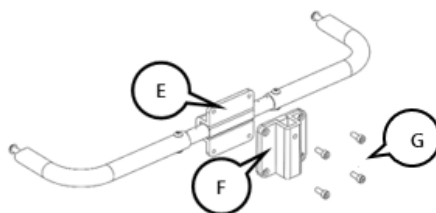

Installer la barre de poussée réglable en angle (option)

La base de positionnement doit être munie de montants conçus précisément pour l'installation de la barre de poussée réglable en angle. Si la base est présentement équipée de montants verticaux 0°, vous devez changer ceux-ci avant de débiter l'installation de la barre de poussée en suivant les étapes 1 à 5. Si la base est déjà équipée de montants pour barre de poussée, vous pouvez passer directement aux étapes 6 à 9.



1. Enlevez la barre de tension **A** en dévissant les vis **B** avec une clé Allen de 4mm;
2. Retirez les poignées de bascule, en dévissant les vis avec un tournevis Phillips (étoile) (voir section *Installer la poignée d'activation*);
3. Dévissez les vis **C** avec une clé de 10mm et retirez les montants de dossier **D**;
4. Installez les montants de dossier pour barre de poussée **E** et resserrez les vis **C**;
5. Insérez les adaptateurs **F** dans les montants de dossier et vissez les vis **G**;
6. Réinstallez la barre de tension sur les montants pour barre de poussée
7. Dévissez complètement les vis **H** avec une clé Allen de 3 mm, pour élargir ou rétrécir la largeur de la barre de poussée telle que voulue, et revissez fermement les vis **H**;
8. Insérez la barre de poussée au bout des adaptateurs et serrez les vis **I** avec une clé Allen de 3mm;
9. Réinstallez les poignées de bascule en vissant les vis avec un tournevis Phillip (étoile).

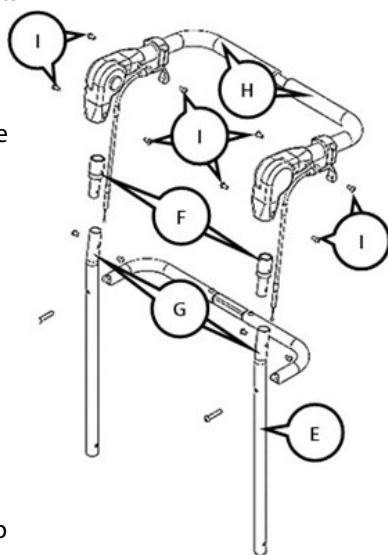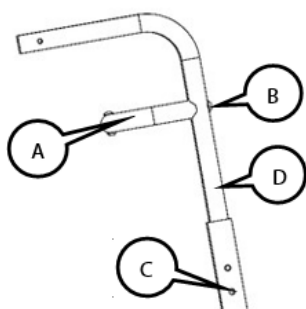

FRANÇAIS

Ajuster l'angle de l'extension de la barre de poussée :


Pour ajuster la barre de poussée, il suffit d'appuyer sur les boutons-poussoirs A simultanément. Cela permettra à la barre de poussée de tourner librement. Lorsque la position désirée sera atteinte, relâchez les boutons poussoir et la barre de poussée se barrera automatiquement.

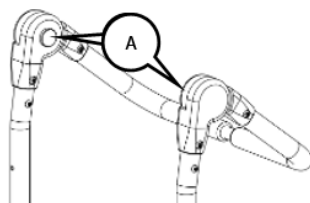**AVERTISSEMENT**

Ne jamais soulever ou tirer la base de positionnement avec la barre de poussée, celle-ci a été conçue pour pousser et diriger la base de positionnement seulement. Une mauvaise utilisation peut provoquer un bris de la barre de poussée et causer des blessures.


Installer la poignée d'activation

1. Positionnez les deux parties de la poignée d'activation sur la poignée du montant;
2. Fixez les deux vis **A** avec un tournevis Phillips (étoile).



Basculer

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic peut être équipée d'un système de bascule. Le système de bascule permet à l'individu de changer de position durant la journée pour prévenir les points de pression et optimiser son confort.

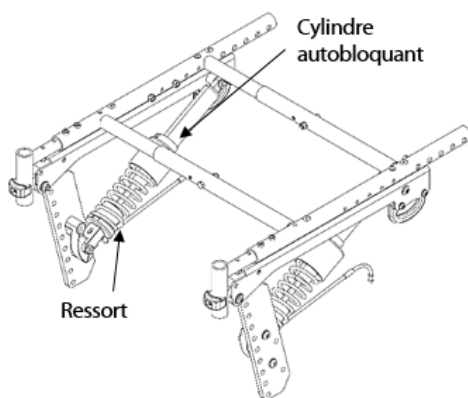


Roues motrices	Hauteur siège/sol	Profondeur d'assise		Profondeur d'assise		Profondeur d'assise	
		14" à 16"		17" à 19"		20" à 22"	
		T	U	T	U	T	U
12" ** (c.s.)	13"	30°	12°	30°	10°	30°	8°
	14"	30°	16°	30°	14°	30°	10°
	15"	30°	20°	30°	17°	30°	13°
	16"	30°	24°	30°	21°	30°	16°
	17"	30°	28°	30°	24°	30°	19°
20"	13"	30°	5°	30°	6°	30°	3°
	14"	30°	9°	30°	9°	30°	7°
	15"	30°	13°	30°	12°	30°	8°
	16"	30°	16°	30°	16°	30°	11°
	17"	30°	21°	30°	19°	30°	14°
22"	14"	30°	6°	30°	4°	30°	4°
	15"	30°	10°	30°	8°	30°	7°
	16"	30°	14°	30°	11°	30°	9°
	17"	30°	20°	30°	14°	30°	11°
	18"	30°	28°	30°	17°	30°	15°
24"	15"	30°	6°	30°	4°	30°	4°
	16"	30°	10°	30°	8°	30°	7°
	17"	30°	14°	30°	11°	30°	9°
	18"	30°	20°	30°	14°	30°	11°
	19"	30°	28°	30°	17°	30°	15°

Note : L'accoudoir en U, le frein au pied, le dossier dynamique et le support bonbonne peuvent influencer les résultats.

FRANÇAIS


Limiter l'inclinaison du système de bascule

1. Avec une clé Allen de 7/64", dévissez les vis **A** situées sur le collet de serrage **B** ;
2. Positionnez le collet de serrage **B** à l'emplacement voulu sur la tige de cylindre **C** ;
3. Resserrez les vis.

**Remplacer le cylindre**

Le système de bascule est installé directement sur la chaîne de montage, si vous devez remplacer le cylindre, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'assise est parallèle au sol, voir Ajuster l'inclinaison de la bascule (cette étape est très importante pour la sécurité lors du remplacement);
2. Dévissez et retirez le câble d'activation;
3. Dévissez et retirez les vis **A** avec une clé de 4 mm;
4. Dévissez la vis **B** avec une clé Allen de 4 mm et une clé de 10 mm;
5. Dévissez les vis **C** avec une clé Allen de 4 mm;
6. Dévissez l'embout du cylindre **D** avec une clé de 19 mm et installez sur le nouveau cylindre;
7. Remplacez la vis **C** avec la clé Allen de 4 mm;
8. Remplacez la vis **B** avec une clé Allen de 4 mm et une clé de 10 mm;
9. Remplacez les vis **A** avec une clé Allen de 4 mm;

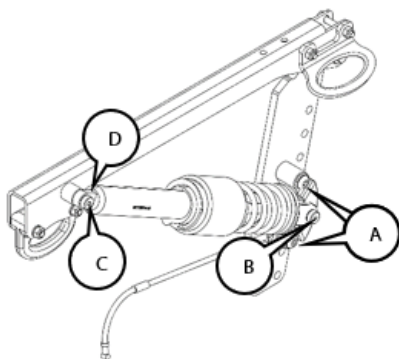


Note – Assurez-vous que toute la quincaillerie soit réinstallée comme il le faut et que chacune des vis soient bien serrées.

10. Vissez le câble au nouveau cylindre.

Ajuster l'inclinaison de la bascule

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic peut être basculée vers l'arrière en se référant à la méthode suivante :

1. Lors de la mise en bascule, actionnez les freins de stationnement **A**.
2. Actionnez la bascule en pressant simultanément sur la poignée **B**;
3. Relâchez les poignées à l'angle de bascule désiré;
4. Au besoin, l'angle de bascule maximal peut être limité, voir Limiter l'inclinaison du système de bascule.

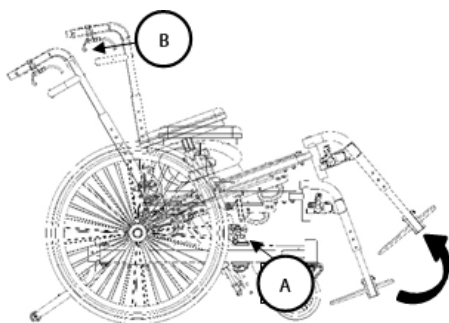

AVERTISSEMENT

- Ne jamais remplacer de pièces sur le système de bascule, si le système est incliné.
- Lors de l'ajustement d'inclinaison de la bascule, s'assurer que rien ne se trouve sous le fauteuil ou près du système de bascule.

FRANÇAIS

Accoudoirs


Accoudoir en « U »

L'accoudoir en « U » étant composé d'une garniture rembourrée de mousse est rabattable et facilite les transferts.

Il offre une plage d'ajustement en hauteur de 6 ¾" à 16 ½" (152 mm à 406 mm).
Réglable par incrément de ½".

Installer l'accoudoir en « U »

1. Dévissez la vis **A** avec une clé Allen de 4mm en utilisant une clé de 10 mm pour maintenir l'écrou **B** en place;
2. Fixez le récepteur arrière **C** sur la plaque de positionnement;
3. Resserrez la vis **A** et l'écrou **B** avec une clé Allen de 4mm et une clé de 10 mm;
4. Fixez le récepteur avant **F** sur le longeron avec deux clés de 10mm.

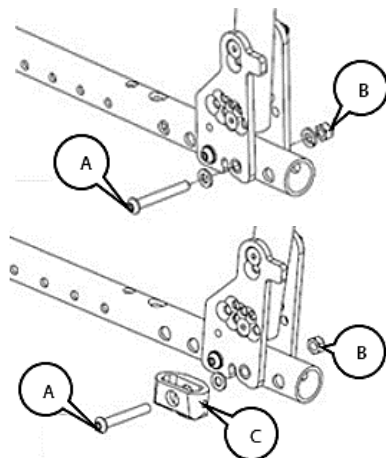


Rabattre l'accoudoir en « U »

1. Appuyez sur le déclencheur **G**;
2. Basculez l'accoudoir vers l'arrière.

Régler l'accoudoir en « U » en hauteur

1. Appuyez sur le déclencheur **H**;
2. Montez ou descendez l'accoudoir;
3. Relâchez le déclencheur pour conserver la hauteur désirée.

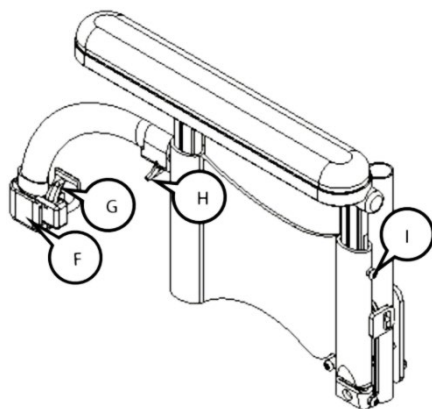


Note - Assurez-vous que l'accoudoir est bien enclenché dans un trou d'ajustement et que la vis de blocage **I** est bien resserrée.

Accoudoir en « T »

L'accoudoir en « T » étant composé d'une garniture rembourrée de mousse, est amovible pour faciliter les transferts. Il offre les plages d'ajustement en hauteur suivantes: 8" à 15 ½" (200 mm à 381 mm), réglables par incrément de ½".


Installer le récepteur d'accoudoir

1. Positionnez le récepteur **A** sur le longeron, vis-à-vis les trous d'ajustement;
2. Fixez en place avec les vis **B**, à l'aide d'une clé Allen de 5 mm et maintenez les écrous **C** en place à l'aide d'une clé de 10 mm.

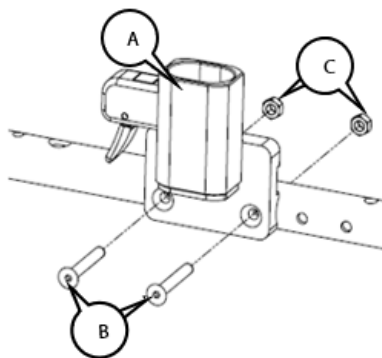

Installer l'accoudoir en « T »


1. Pour mettre l'accoudoir en place, maintenez le levier de déclenchement **D** enfoncé;
2. Insérez l'accoudoir dans le récepteur **A**;
3. Relâchez le levier de déclenchement **D**, l'accoudoir s'enclenchera.

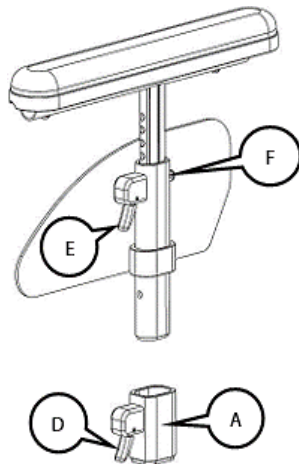

FRANÇAIS

Régler l'accoudoir en « T » en hauteur

1. Appuyez sur le déclencheur **E**;
2. Faites monter ou descendre l'accoudoir;
3. Relâchez le déclencheur **E** une fois que la hauteur désirée est atteinte;
4. Pour conserver la hauteur, vissez la vis de blocage **F** avec une clé Allen de 4mm.

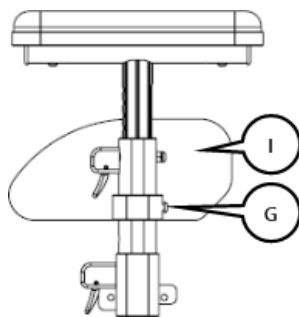

Note - Assurez-vous que l'accoudoir est bien enclenché dans un trou d'ajustement et que la vis de blocage **F** est bien resserrée.

Régler le protège-vêtements en hauteur

1. Desserrez la vis **G** avec une clé de 4 mm;
2. Positionnez le protège vêtements **I** à la hauteur désirée;
3. Resserrez la vis **G** fermement en place.

Retirer l'accoudoir en « T »

1. Appuyez sur le déclencheur **D**;
2. Soulevez l'accoudoir pour le retirer.

Repose-jambe

Le repose-jambe est amovible et pivotant vers l'intérieur et l'extérieur et est muni de repose-pied rabattable seulement, ou rabattable et réglable en profondeur et en angle. Le repose-jambe est offert en trois modèles : 60°, 70° et 90°.

Chaque modèle offre une grande plage d'ajustement pour assurer un soutien optimal des membres inférieurs.

Repose-jambe 60° : 11 ¼" à 21" (280 mm à 530 mm)


Repose-jambe 70° : 10 ¾" à 20 ½" (255 mm à 508 mm)

Repose-jambe 90° : 10 ½" à 20 ½" (254 mm à 508 mm)

Réglables par incrément de ½".


Installer le repose-jambe

1. Insérez le pivot d'ancrage **A** du repose-jambe dans la cavité du châssis avant;
2. Tournez le repose-jambe vers l'intérieur jusqu'à la fermeture du déclencheur.



Retirer le repose-jambe

1. Appuyez et maintenez le déclencheur **B** enfoncé tout en tournant le repose-jambe vers l'extérieur;
2. Soulevez le repose-jambe pour le retirer complètement.

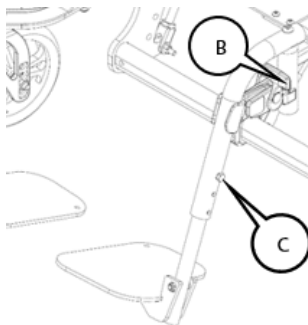

Ajuster la hauteur du repose-jambe

1. Retirez la vis **C** avec une clé Allen de 10 mm;
2. Faites coulisser la tige de rallonge du repose-jambe à la hauteur désirée;
3. Réinstallez la vis **C** dans le trou d'ajustement approprié et resserrez.


FRANÇAIS

Rabattre le repose-pied

Pour rabattre le repose-pied, il suffit de le faire pivoter vers le haut afin de le relever complètement.

Régler en profondeur les palettes du repose- pied

1. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, desserrez les deux vis **D** et retirez;
2. Positionnez la palette dans les trous d'ajustement appropriés et resserrez les deux vis **D**.


**Régler l'angle horizontal du repose-pied**

1. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, dévissez les deux vis **D**, sans les retirer;
2. Faites pivoter la palette pour ajuster l'angle horizontal **B**;
3. Resserrez les deux vis **D**.

Ajuster l'angle vertical du repose-pied

Tournez la vis plastique **E** sous le repose-pied à l'aide d'une clé Allen de 1/4" pour ajuster l'angle voulu;

- L'action de visser permet d'augmenter l'angle;
- L'action de dévisser permet de le diminuer.


**AVERTISSEMENT**

Ne jamais soulever le fauteuil roulant par les repose-pieds. Des bris ou des blessures pourraient survenir. Utilisez plutôt les éléments rigides du châssis.

Repose-jambe élévateur

Installer le repose-jambe élévateur

1. Placez le repose-jambe perpendiculaire au fauteuil roulant;
2. Installez l'embout de tige **A** dans le réceptacle du châssis;
3. Poussez le repose-jambe vers l'intérieur du fauteuil roulant afin de le placer en position barrée.

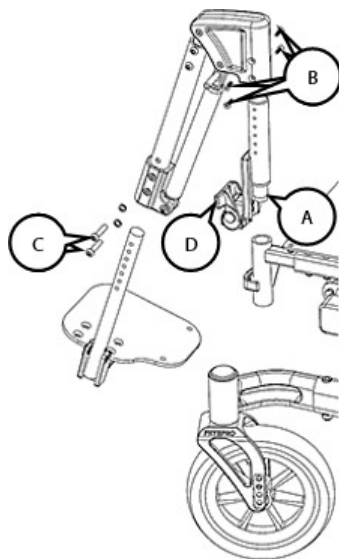

Ajustement en hauteur au niveau des genoux

1. Desserrez les 4 boulons **B** avec une clé Allen de 2.5mm;
2. Descendez la partie supérieure du repose-jambe sur la tige;
3. Positionnez celle-ci à la hauteur désirée, vis-à-vis les trous d'ajustement appropriés;
4. Resserrez les boulons **B** fermement.

Ajuster la longueur du repose-jambe

1. Dévissez les vis **C** avec une clé Allen de 4mm;
2. Faites coulisser le sous assemblage inférieur du repose-pied à la hauteur désirée;
3. Resserrez les vis **C** dans les trous d'ajustement appropriés.



Retirer le repose-jambe

1. Tirez le déclencheur **D** vers soi;
2. Tournez le repose-jambe vers l'intérieur ou l'extérieur et soulevez-le.

FRANÇAIS

Ajuster l'angle du repose-jambe élévateur

1. Pour augmenter l'angle, tirez le repose-jambe vers le haut;
2. Pour diminuer l'angle, appuyez sur le déclencheur **E** et maintenez-le enfoncé, en poussant le repose-jambe vers le bas.

Freins de stationnement


L'installation d'un système de frein de stationnement doit se faire une fois que les roues motrices sont correctement ajustées et installées. Sachez que la dimension des roues motrices aura une influence sur la position du support de frein. Si vos roues ne sont pas installées, consultez la section Installer les roues motrices avec l'essieu fileté ou Installer les roues motrices avec l'essieu à dégagement rapide, selon votre type d'essieu.

**AVERTISSEMENT**

- Si votre base de positionnement est équipée avec des pneus de type pneumatique, assurez-vous que la pression des pneus est adéquate avant tout ajustement.
- Prenez soin de resserrer fermement les écrous après chaque réglage.
- Il est important d'ajuster les freins si des modifications sont apportées aux roues motrices ou si les roues sont usées.



Installer le système de freinage standard

1. Positionnez le support de frein;
2. Insérez les vis **A** dans le trou d'ajustement approprié.
3. Fixez solidement le support de frein en vissant la vis **A** et l'écrou **B** avec deux clés de 13 mm.

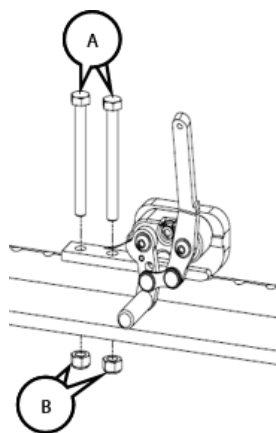

Ajuster la force de freinage appliquée

1. Desserrez le boulon **C** avec une clé Allen de 5 mm;
2. Déplacez le bloc de frein dans la fente **D**, selon le cas, vers la roue pour augmenter la force de freinage ou dans le sens inverse pour diminuer la force de freinage;
3. Resserrez le boulon **C**;
4. Faites l'essai et réajustez jusqu'à obtention de la tension voulue et vérifiez l'efficacité du système de blocage de la roue;
5. Au besoin, vous pouvez modifier l'emplacement du support de frein, en dévissant les vis **A** et en déplaçant le support sur le châssis;
6. Vissez fermement une fois le réglage effectué.




Note - La tige de frein devrait s'enfoncer de $\frac{1}{8}$ " à $\frac{1}{4}$ " dans le pneu lorsqu'il est appliqué.

Appliquer les freins

Freins standard à blocage par


poussée : Pour actionner les freins, poussez la poignée **E** vers l'avant; Pour libérer les freins, tirez la poignée **E** vers l'arrière.



Frein par poussée

Freins standard à blocage par traction :

Pour actionner les freins, tirez la poignée **E** vers l'arrière; Pour libérer les freins, poussez la poignée **E** vers l'avant.



Frein par traction


FRANÇAIS

**AVERTISSEMENT**

- Ne pas tenter d'arrêter un fauteuil en mouvement en actionnant les freins. Ces freins permettent de bloquer la roue mais ne doivent en aucun cas être utilisés pour immobiliser le fauteuil lorsqu'il roule.
- Lorsque les freins sont appliqués, la tige de frein doit s'enfoncer de $\frac{1}{8}$ " à $\frac{1}{4}$ " dans le pneu.

Frein au pied (option 4 roues ou 6 roues)**Installer le système de freinage au pied**

1. Ajustez les parties **A** et **B** selon la largeur du châssis en les insérant dans le tube **C**;
2. Positionnez et ajustez l'ancrage du système de frein au pied **E** sur le châssis en vissant les boulons **F** avec deux clés de 13 mm;
3. Centrez le tube **C** et vissez les vis **D** à l'aide d'une clé de 10 mm.

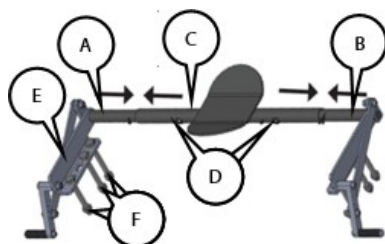
**Ajuster la force de freinage appliquée**

1. Dévissez les boulons **F** et avancez ou reculez l'assemblage dans la fented'ajustement.
 - Si le frein est trop serré, reculez l'assemblage;
 - Si le frein est trop lâche, avancez l'assemblage.
2. Resserrez les boulons **F**.

Note - Assurez-vous que les tiges des freins **G** sont à environ $\frac{1}{2}$ " des roues quand le frein n'est pas actionné.

Appliquer le frein au pied

1. Actionnez le frein en pressant la palette du côté **H**.
2. Pour libérer le frein, pressez la palette du côté **I**.

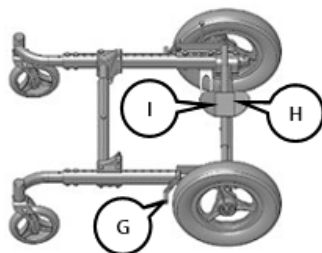


Anti-basculants

Les Équipements adaptés Physipro Inc. recommande l'installation d'anti-basculants sur toutes les bases de positionnement.

Installer les anti-basculants

1. Appuyez sur le boutons-poussoir **A** pour que la goupille de blocage soit ramenée à l'intérieur;
2. Introduisez l'anti-basculant dans le récepteur;
3. Enfoncez le tube en tournant jusqu'à ce que la goupille s'engage dans le trou de montage du récepteur;
4. Répétez ces mêmes étapes pour le deuxième anti-basculant.

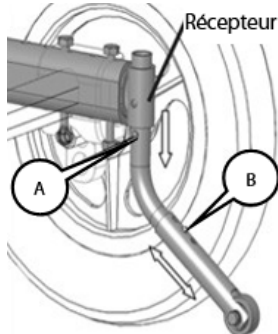

Note - Pour une sécurité maximum, il est recommandé d'installer l'anti-basculant au maximum à 2" du sol.

Ajustement des anti-basculants

Lorsque les anti-basculant sont installés, il est important d'ajuster la hauteur de ceux-ci.

1. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** et montez ou descendez le tube d'ajustement de l'anti-basculant jusqu'à ce que le bouton-poussoir **B** passe à travers le trou d'ajustement désiré;
2. Répétez ces étapes avec le second anti-basculant.

Enlever les anti-basculants


Pour enlever les anti-basculants, il suffit d'appuyer sur le bouton pression **A** et le retirer, en tirant vers le bas.

FRANÇAIS

Dégager les anti-basculants

Tournez les anti-basculants vers l'intérieur de la roue lorsque vous êtes poussé par un assistant ou que vous franchissez un obstacle.

1. Appuyez **A** et maintenir le bouton-poussoir enfoncé;
2. Tournez l'anti-basculant vers l'intérieur;
3. Répétez ces étapes avec le second anti-basculant;
4. Assurez-vous de bien replacer les anti-basculants dans la position initiale lorsque la manœuvre est complétée.

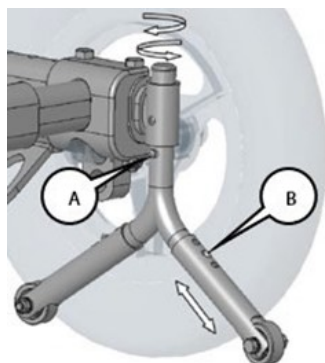**AVERTISSEMENT**

- Assurez-vous que les anti-basculants soient complètement engagés et que les boutons-poussoirs soient complètement à l'extérieur des trous d'ajustements;
- Les anti-basculants risquent de ne pas fournir le même niveau de protection contre le basculement, lorsque vous êtes à l'extérieur sur une surface mouillée, sur un terrain argileux, sableux, neigeux, ou sur une surface couverte de gravier;
- Pour une sécurité maximum, il est recommandé d'installer l'anti-basculant au maximum à 2" du sol. Un ajustement trop bas des anti-basculants peut faire en sorte que vous rencontriez de la difficulté à franchir certains obstacles courants, tandis qu'un ajustement trop haut augmente le risque de basculer vers l'arrière. Assurez-vous que les deux anti-basculants soient ajustés dans les mêmes trous d'ajustement;
- Assurez-vous que les deux anti-basculants soient à la même hauteur;
- Les Équipements adaptés Physipro Inc. recommande l'installation d'anti-basculants sur tous les fauteuils roulants et bases de positionnement;
- Ne jamais utiliser les anti-basculants comme levier de bascule.

5. Transport

La base de positionnement Neox^{MC} Dynamic a été conçue et est munie d'ancrages de transport installés en usine pour permettre l'accès au transport adapté.

Veuillez lire attentivement le document intitulé *Fiche technique – Utilisation comme siège dans les véhicules à moteur*, pour connaître les spécifications relatives de votre base de positionnement, page 68.

Si vous désirez voyager dans un véhicule routier qui n'est pas approuvé par Transport Canada comme véhicule du transport adapté, il est primordial de lire les avertissements suivants au préalable :

- N'utilisez jamais la base de positionnement en tant que siège dans un véhicule motorisé. En cas d'accident ou d'arrêt brusque, l'utilisateur/l'utilisatrice risque d'être éjecté(e) et de subir de graves blessures. Les sangles et les ceintures de positionnement ne sont pas conçues pour protéger l'utilisateur/l'utilisatrice dans de tels situations et risque même de causer des blessures;
- Lorsque vous êtes à bord d'un véhicule motorisé, veillez à ce que votre base de positionnement soit placée dans un lieu sécuritaire. Nous recommandons de placer la base de positionnement dans le coffre de la voiture, si possible, et de la sécuriser avec des sangles de fixation (sangles élastiques);
- Placez toujours l'utilisateur/l'utilisatrice dans un siège approuvé du véhicule, en utilisant les dispositifs de retenue appropriés du véhicule;
- N'utilisez pas une base de positionnement qui a été impliquée dans un accident routier, sans inspection approfondie. Cessez l'utilisation de la base de positionnement si elle présente le moindre signe de dommage.

FRANÇAIS

FICHE TECHNIQUE - UTILISATION COMME SIÈGE DANS LES
VÉHICULES À MOTEUR

Lisez l'ensemble de ce manuel avant d'utiliser votre base de positionnement à bord d'un véhicule adapté. Assurez-vous d'utiliser un système de ceinture de sécurité et un système d'arrimage de la base de positionnement répondant aux normes ISO/DIS 7176-19:2019 au risque de blessures physiques graves, voire mortelles.

Pour toutes questions concernant l'utilisation de cette base de positionnement pour le transport adapté, communiquez avec Les Équipements adaptés Physipro Inc. au numéro suivant : 1 800 668-2252.

INTRODUCTION

Les bases de positionnement Neox^{MC} et Neox^{MC} Dynamic de Physipro^{MD} répondent à la norme ISO/DIS 7176-19:2019 et, par conséquent, sont conçues pour être fixées face à la route lorsqu'elles sont utilisées comme siège de transport dans un véhicule à moteur.

Note : La conformité à la norme ISO/DIS 7176-19:2019 n'empêche pas d'utiliser les bases de positionnement tournées vers l'arrière dans les grands véhicules accessibles équipés de postes passagers orientés vers l'arrière.

Les bases de positionnement Neox^{MC} et Neox^{MC} Dynamic de Physipro^{MD} sont munies de dispositifs de retenue de ceinture fixés à même leur structure répondant à la norme ISO/DIS 7176-19:2019 et ont réussies les tests d'impact frontal avec un mannequin d'essai de choc ayant une taille moyenne et un poids de 76.3 kg (170 lb).

Les bases de positionnement Physipro^{MD} utilisent des ancrages de transport installés en usine. Le système d'arrimage adapté aux modèles de bases de positionnement Neox^{MC} et Neox^{MC} Dynamic est du type « sangle à 4 points ».



AVERTISSEMENT**Limitations :**

- La norme ISO/DIS 7176-19:2019 n'analyse les performances d'une base de positionnement fixée dans une position vers l'avant que dans des collisions frontales à 48 km/h (30 mi/h).
- Les bases de positionnement Physipro^{MD} ne répondent aux tests requis par la norme ISO/DIS 7176-19:2019 que sous les configurations décrites à la page 77. Les bases de positionnement présentant des configurations différentes ou des systèmes de siège autres que ceux provenant du présent fabricant n'ont pas été testées. Les Équipements adaptés Physipro Inc. ne pourrait donc pas garantir la performance de ses bases de positionnement dans d'autres configurations face à la norme ISO/DIS 7176-19:2019.
- La conformité à la norme ISO/DIS 7176-19:2019 ne prévient pas les blessures ou la mort de l'occupant impliqué dans un accident de véhicule même si la base de positionnement répond à la norme.

En cas d'accident :

- À la suite d'une collision, cessez l'utilisation de votre base de positionnement. Les dommages structurels subis par la base de positionnement peuvent être invisibles à l'œil nu.
- La base de positionnement doit être inspectée par un représentant du fabricant avant d'être réutilisée après avoir été impliquée dans tout type de collision de véhicule.
- **AVERTISSEMENT** : La garantie s'annule pour toute base de positionnement ayant été impliquée dans une collision.

FRANÇAIS**Transport à bord d'un véhicule motorisé :**

- Les occupants de base de positionnement devraient utiliser le siège du véhicule et utiliser les systèmes de retenue de celui-ci chaque fois qu'un transfert est possible. La base de positionnement inoccupée devrait alors être rangée dans une zone de cargaison ou fixée dans le véhicule pendant le voyage.
- Lorsque le transport adapté est requis, le véhicule motorisé utilisé doit être muni d'un système d'arrimage et de retenue répondant aux normes ISO/DIS 7176-19:2019.
- Les bases de positionnement Physipro^{MD} ont été testées dynamiquement dans une orientation face à la route avec l'occupant retenu par une ceinture pelvienne et une ceinture du torse supérieur. Une ceinture pelvienne et une ceinture du torse supérieur devraient donc être utilisées pour réduire les risques d'impacts de la tête et de la poitrine de l'utilisateur avec les composants du véhicule.
- Notez que la facilité d'accès et la manœuvrabilité dans les véhicules à moteur peuvent être fortement diminuées par la taille de la base de positionnement et le diamètre de braquage plus court facilitant généralement l'accès au véhicule et la manœuvrabilité en position face à la route.

Modifications de la base de positionnement :

- Ne retirez pas les points de fixation des sangles d'arrimage permettant de retenir votre base de positionnement à un véhicule à moteur. Si les points de fixation des sangles d'arrimage sont retirés, ils ne pourront être remis en place et votre base de positionnement ne sera plus conforme à l'ISO/DIS 7176-19:2019.
- Aucune modification ou substitution ne doit être apportée aux points de fixation de votre base de positionnement ou aux pièces et composants de sa structure et de son châssis sans autorisation préalable de Les Équipements adaptés Physipro Inc.

Limite de poids :


- La limite de poids (pour l'occupant ainsi que tous les accessoires fixés à la base de positionnement) est de 120 kg (265 lb) pour l'utilisation à bord d'un véhicule adapté. N'utilisez pas la base de positionnement lors du transport si le poids total est supérieur à la limite.

Inspection :

- Une inspection visuelle régulière de l'ensemble d'arrimage pour transport adapté est requise.

ASSURER LA BASE DE POSITIONNEMENT AU VÉHICULE

- Fixer les sangles d'ancrage aux points de fixation de la base de positionnement tel qu'indiqué à la figure 1. Les points de fixation destinés au transport adapté sont indiqués par des symboles de point de fixation sur la base de positionnement. (Voir figure 2)

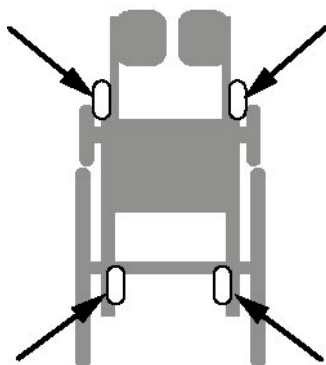DEVANT DU VÉHICULE*Figure 1**Figure 2*

- Ne fixez jamais les crochets d'arrimage à un autre emplacement sur la base de positionnement que sur les points de fixation désignés à cet effet.
- Assurez-vous que les sangles d'arrimage soient bien serrées.

FRANÇAIS

- Pour fixer la base de positionnement au véhicule, installez les sangles d'arrimage arrière aux points de fixation arrière de la base de positionnement. Pour les sangles d'arrimage avant, assurez-vous que les points d'attaches au sol aient une position plus large que la base de positionnement afin d'assurer une meilleure stabilité latérale. (Voir figure 3)



Figure 3

AVERTISSEMENT

- Les bases de positionnement Neox^{MC} et Neox^{MC} Dynamic de Physipro^{MD} ont été testées et peuvent être utilisées avec tous les systèmes de fixation de la base de positionnement et de retenue des occupants répondant aux normes ISO 10542-1.

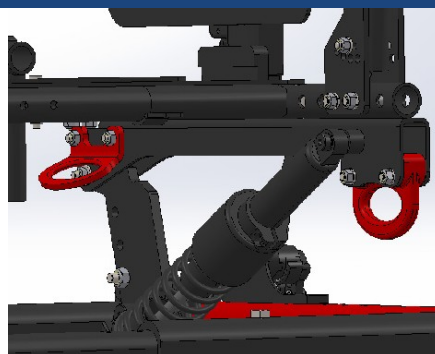
EXEMPLE DE POINT D'ANCRAGE

Figure 4

ZONE DE DÉGAGEMENT DE LA BASE DE POSITIONNEMENT DANS UN VÉHICULE

Votre base de positionnement doit être fixée dans une position vers l'avant lors d'un déplacement à l'intérieur d'un véhicule motorisé. Les zones de dégagements requises lorsqu'une ceinture pelvienne et une ceinture du torse supérieur sont utilisées sont les suivantes :

Zone de dégagement frontal (FCZ) : Cette zone est mesurée à partir du point le plus en avant de la tête de l'occupant et doit mesurer 26 pouces (66 cm) minimum. **Note :** La zone de dégagement frontal peut ne pas être atteignable pour les conducteurs de véhicule occupant une base de positionnement.

Zone de dégagement arrière (RCZ) : Cette zone est mesurée à partir du point le plus en arrière de la tête de l'usager et doit mesurer 16 pouces (40,64 cm) minimum. Il ne doit y avoir aucune obstruction dans cette zone.

Hauteur de la tête en position assise (HHT) : Cette mesure du sol au sommet de la tête de l'occupant varie d'environ 47 pouces (120 cm) pour un adulte de petite taille à environ 61 pouces (155 cm) pour un adulte de grande taille.

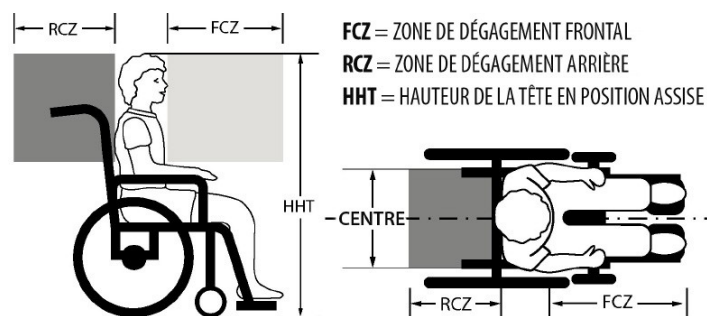


Figure 5

FRANÇAIS

AVERTISSEMENT :

Sécurisation des accessoires :

- Afin de réduire les risques de blessures pour les occupants du véhicule, les plateaux montés sur une base de positionnement non spécialement conçus pour la sécurité en cas d'accident doivent être retirés et fixés séparément dans le véhicule ou fixés à la base de positionnement, mais placés à l'écart de l'occupant avec un rembourrage absorbant les chocs, placé entre le plateau et l'occupant.
- Tout équipement auxiliaire à la base de positionnement doit être parfaitement fixé à cette dernière ou retiré et disposé dans un endroit sécuritaire lors du déplacement pour réduire les risques de blessure.
- Lorsqu'ils ne peuvent être retirés, les accessoires auxiliaires (tel que des appareils respiratoires ou supports pour intraveineuse) doivent être positionnés loin de l'occupant et rembourrés de telle sorte que les chocs soient absorbés dans l'éventualité d'un accident. Assurez-vous que le rembourrage soit effectué avec un matériel répondant aux normes FMVSS201.

POSITIONNEMENT DE L'USAGER

Réglages de la base de positionnement :

- Lors du transport, assurez-vous que l'angle du dossier de votre base de positionnement ne soit pas réglé à un angle de plus de 30 degrés par rapport à la verticale au risque de blessures pour l'utilisateur.
- Les bases de positionnement ayant un angle de siège ajustable doivent être réglées à un angle de 10 degrés.

Protection du cou et de la tête :

- Assurez-vous que l'occupant est bien positionné à l'intérieur de la base de positionnement afin de protéger son cou et sa tête en cas de collision.
- Privilégiez l'utilisation d'un appui-tête lors du transport adapté afin de réduire les risques de blessures au cou et à la tête en cas d'accident.

CEINTURE DE SÉCURITÉ À TROIS POINTS

Positionnement :

- 1- Positionnez la ceinture pelvienne basse sur le devant du bassin. Cette dernière doit autant entrer en contact avec le pelvis que les deux hanches de l'occupant. La ceinture pelvienne doit préférablement former un angle de 45 à 75 degrés par rapport à l'horizontale. Si cette norme ne peut être atteinte, une zone optionnelle de 30 à 45 degrés par rapport à l'horizontale peut être utilisée sécuritairement. (Voir figure 6)

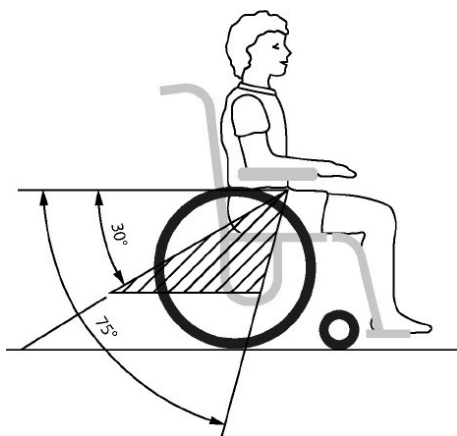


Figure 6

- 2- La création d'un angle de ceinture plus prononcé dans la zone préférée est souhaitable. Un angle plus raide réduira la tendance à un espace vertical de se développer entre l'utilisateur et la ceinture. Les risques de l'utilisateur de glisser sous la ceinture seront ainsi réduits.

FRANÇAIS

- 3- La ceinture du torse supérieur doit avoir plein contact avec le sternum et la surface antérieure de l'épaule de l'occupant. Elle doit être positionnée au milieu de l'épaule et le centre de la poitrine. Son point d'ancrage supérieur doit être situé au-dessus et derrière l'utilisateur afin de le maintenir en place pendant le transport. (Voir figure 7)



Figure 7

- 4- Les ceintures doivent être tenues près du corps de l'utilisateur et ne doivent pas être tenues à distance de celui-ci par des composants ou des pièces de la base de positionnement (par exemple, par les appui-bras ou les roues). Afin d'optimiser le positionnement de la ceinture pelvienne et de la ceinture du torse supérieur sur l'occupant, il peut être nécessaire d'insérer la courroie de la ceinture pelvienne entre l'appui-bras et le dossier ou à travers des ouvertures entre le dossier et le siège afin d'éviter de placer la courroie sur l'appui-bras. (Voir figure 8 et 9)

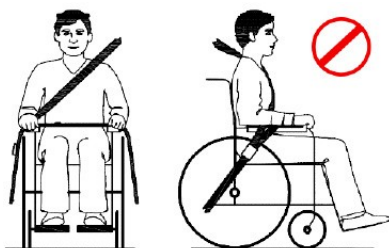


Figure 8

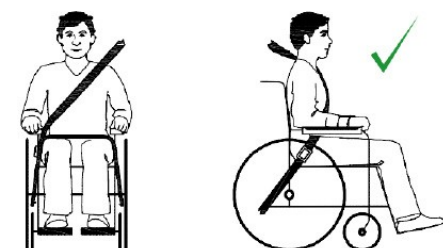


Figure 9

- 5- Le trajet de la ceinture de sécurité entre l'occupant et les points d'ancrage des deux côtés de la base de positionnement ne doit pas s'écarter de plus de 5 degrés d'une ligne droite.
- 6- Assurez-vous que les courroies des ceintures ne soient pas tordues.
- 7- Ajustez les ceintures aussi fermement que possible en veillant à ne pas restreindre le flux sanguin ou la respiration de l'occupant.

AVERTISSEMENT :

Ceinture de sécurité :

- Les supports posturaux ne doivent pas être utilisés pour la retenue des occupants dans un véhicule en mouvement, sauf s'ils sont étiquetés comme étant conformes aux exigences spécifiées dans la norme ISO/DIS 7176-19:2019.
- Prenez soin de positionner la ceinture de sécurité de sorte que les composants de la base de positionnement ne puissent pas entrer en contact avec sa boucle et activer son ouverture lors d'une collision.

Notation selon la norme ISO/DIS 7176-19:2019 :

- Notation de la facilité à utiliser la ceinture de sécurité à trois points du véhicule à moteur comme l'exige la norme ISO/DIS 7176-19:2019 :
 - o **Neox^{MC} Dynamic** - "Excellent"
- Notation du degré auquel l'utilisation de la ceinture de sécurité à trois points du véhicule à moteur permet de bien sécuriser l'occupant comme l'exige la norme ISO/DIS 7176-19:2019 :
 - o **Neox^{MC} Dynamic** - "Excellent"

CONFIGURATION LORS DES TESTS

TABLEAU DE CONFIGURATION MESURÉE SELON LA NORME ISO 7176-7

Neox ^{MC} Dynamic	18" (largeur) x 18" (profondeur) x 18" (HSS*), hauteur de dossier 20"
----------------------------	--

MASSE DE LA BASE DE POSITIONNEMENT MESURÉE SELON LA NORME ISO 7176-5

Neox ^{MC} Dynamic	32.55 kg (71.6 lbs)
----------------------------	---------------------

CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE DE L'OCCUPANT MESURÉE SELON LA NORME ISO 7176-11

Neox ^{MC} Dynamic	120 kg (265 lb)
----------------------------	-----------------

*HSS : Hauteur Siège Sol



FRANÇAIS

6. Nettoyage et Entretien

Le nettoyage et l'entretien permettent de prolonger la durée de vie de votre base de positionnement. Il est recommandé de vérifier chaque composant de votre base de positionnement lors du nettoyage.

Recommandations générales

- Éliminez toutes souillures (alimentaires et/ou biologiques) immédiatement sans attendre le nettoyage hebdomadaire;
- Si une personne malade est infectieuse : désinfectez au quotidien le coussin de siège, les accoudoirs, le dossier et tout autre surface à l'aide d'un désinfectant en pulvérisant la surface.

Nettoyage

Châssis et les surfaces peintes

Un nettoyage hebdomadaire est recommandé.

1. Nettoyez les surfaces peintes avec un savon doux ou un détergent neutre dilué dans l'eau (2 onces (6 cl) pour 8L d'eau) et bien rincer;
2. Séchez complètement les surfaces avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité.

Un entretien à tous les (3) trois mois avec la cire automobile non abrasive permet de protéger le châssis et les pièces peintes.

1. Nettoyez et séchez complètement les surfaces peintes de la base de positionnement avant l'application de la cire;
2. Appliquez la cire automobile en suivant les instructions indiquées sur l'étiquette du produit;
3. Utilisez un chiffon à microfibres pour le polissage.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
- N'utilisez pas de laveuse à pression.

Essieux et pièces mobiles

Un nettoyage hebdomadaire est recommandé.

1. Enlevez la poussière ou la saleté sur les essieux ou les pièces mobiles;
2. Nettoyez autour des essieux et des pièces mobiles avec un chiffon légèrement humide et séchez avec un chiffon propre.

Dossier souple

Un nettoyage hebdomadaire est recommandé.

1. Essuyez légèrement avec un chiffon humide, avec un savon doux ou un détergent neutre;
2. Épongez doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité;
3. Laissez sécher complètement à l'air libre.



AVERTISSEMENT

Ne jamais laver ou sécher un dossier souple à la machine, ceci peut endommager le tissu.

Garnitures de confort

Un nettoyage hebdomadaire est recommandé.

1. Essuyez légèrement avec un chiffon humide, avec un savon doux ou un détergent neutre;
2. Épongez doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité.
3. Laissez sécher complètement à l'air libre.

FRANÇAIS

Désinfection

La désinfection permet de détruire les agents infectieux et d'éliminer les micro-organismes pathogènes à l'aide de l'utilisation de bactéricide ou virucide.

1. Essuyez les surfaces à désinfecter avec des lingettes humides contenant un minimum de 70% d'alcool;
2. Laissez agir pendant 15 minutes;
3. Rincez avec un chiffon propre et légèrement humide avec de l'eau;
4. Séchez avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité et laissez sécher complètement à l'air libre.

Prendre note que certaines surfaces telles que les poignées des montants de dossier, accoudoirs, cerceaux de conduite, pneus, freins de stationnement et repose-pieds sont en contact direct avec les mains. Une désinfection régulière, voir quotidienne est recommandée.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas des agents de blanchissement (ex. eau de javel) sur les tissus ou courroies de votre base de positionnement.

Entretien

Un bon entretien de votre base de positionnement est essentiel, vous maximiserez ainsi sa durée de vie et vous vous assurerez de votre sécurité lors de l'utilisation.



AVERTISSEMENT

- À la réception de votre base de positionnement, il est important de faire effectuer une vérification approfondie de tous les composants de la base de positionnement pour assurer son bon fonctionnement et assurer votre sécurité.
- Une inspection aux intervalles indiquées dans la Liste de vérification et un entretien régulier des différents composants de votre base est nécessaire pour maintenir votre base de positionnement en bon état.
- Une inspection de votre base de positionnement par un professionnel qualifié est recommandée deux fois par année pour assurer son bon fonctionnement.

Liste de vérification

Liste de vérification	Chaque semaine	Chaque mois	Tous les six mois
Général			
■ Nettoyer les pièces de la base de positionnement	✓		
■ S'assurer que le base roule en ligne droite	✓		
■ S'assurer que toutes les pièces fonctionnent sans mouvement saccadé et qu'aucun bruit ou vibration anormal n'est perçu	✓		
Roues et pneus			
■ S'assurer que la pression des pneus est adéquate (si applicable)	✓		
■ Vérifier que les pneus ne sont pas usés ou déformés		✓	
■ S'assurer que les roues tournent bien		✓	
■ Vérifier l'alignement des roues			✓
■ Vérifier l'angle de cambrure des roues			✓
■ S'assurer que les fourches sont solidement fixées			✓
■ S'assurer que les fourches tournent bien		✓	
■ S'assurer que les cerceaux de conduite sont solidement fixés aux roues			✓
■ Vérifier l'état des cerceaux de conduite		✓	
■ S'assurer que les protèges rayons sont solidement fixés aux roues			✓
■ Garder l'essieu à dégagement rapide propre et huilé		✓	
Mécanisme de fourche escamotable (si applicable)			
■ Vérifier l'état et le bon fonctionnement du mécanisme de fourche escamotable			✓

FRANÇAIS

Freins			
■ Vérifier l'efficacité et l'usure des freins de stationnement		✓	
■ Vérifier que les freins n'interfèrent pas avec le mécanisme des roues		✓	
■ Vérifier l'usure des poignées de freins		✓	
Bascule			
■ Vérifier le bon fonctionnement des poignées d'activation de la bascule et des cylindres		✓	
■ Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile des cylindres		✓	
■ Vérifier que les câbles sont bien fixés et en le bon état		✓	
Bascule électrique (si applicable)			
■ Vérifier le bon fonctionnement des poignées d'activation de la bascule et des cylindres électriques		✓	
■ Vérifier que les câbles sont bien fixés et en le bon état		✓	
Accoudoirs			
■ Vérifier la solidité et l'efficacité des accoudoirs			✓
■ Vérifier le bon fonctionnement des mécanismes d'ajustement en hauteur et escamotable			✓
■ Vérifier l'état et la solidité des protège-vêtements			✓
■ Vérifier l'usure des garnitures du siège, du dossier et des accoudoirs		✓	
Repose-pieds			
■ Vérifier la solidité et l'efficacité des repose-pieds		✓	

■ Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme des repose-pieds amovibles			✓
■ Vérifier l'usure des palettes des repose-pieds			✓
Repose-jambes élévateur (si applicable)			
■ Vérifier la solidité et le bon fonctionnement du repose-jambe élévateur			✓
Siège et dossier			
■ Vérifier la solidité du siège, du dossier, de la barre de tension			✓
■ Vérifier le bon fonctionnement de la barre de poussée (si applicable)			✓
■ Vérifier le bon fonctionnement du dossier dynamique (si applicable)		✓	
■ Vérifier le bon fonctionnement du dossier inclinable à vérin (si applicable)			✓
■ Vérifier l'usure des garnitures du siège et du dossier			✓
Ceinture pelvienne de positionnement			
■ Vérifier l'état et la solidité des sangles de la ceinture pelvienne de positionnement		✓	
■ Assurez-vous du bon fonctionnement de la boucle	✓		
Anti-basculants			
■ Vérifier l'usure et le bon fonctionnement des anti-basculants	✓		
Transport			
■ Vérifier la solidité et l'usure des points de fixation des sangles d'attache pour le transport			✓

FRANÇAIS

Pièces de rechange

Référez-vous à notre site internet pour consulter notre catalogue de pièces. Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 1 800-668-2252, par courriel à info@physipro.com ou nous visiter en personne. Les Équipements adaptés Physipro Inc. est situé au 370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) Canada J1G 2R7.

Procédure de réparation

Toutes les pièces et composants de la base de positionnement, à l'exception des pneus arrière et des chambres à air, doivent être réparés par le fabricant ou un établissement autorisé.

Si votre base de positionnement présente l'un des problèmes suivants : bruit ou vibrations anormales, déviation dans le cadre, roues non alignées, boulons desserrés, désalignement d'une tige de fourche, rayons qui lâche, roulements brisés, ou si vous avez besoin de pièce de remplacement, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1 800 668-2252 ou à info@physipro.com pour avoir la liste complète des établissements autorisés et la procédure à suivre.

Certaines pièces et composants, tels que les roues, accoudoirs, repose-pieds, toile de siège et coussins peuvent être enlevés et envoyés à un établissement offrant des services d'entretien (voir liste ci-dessous) pour la réparation, après avoir reçu l'approbation écrite de Les Équipements adaptés Physipro Inc.

Certains détaillants peuvent offrir des unités de remplacement pendant la période de service. Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant.

Les Équipements adaptés Physipro Inc. tiendra des pièces de rechange pour un minimum de 10 ans ou proposera une option de rechange compatible.

Établissements offrant des services d'entretien

CIUSSS du Bas-Saint Laurent

800, avenue Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 3L6

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

2230, rue de l'Hôpital
Jonquière (Québec) G7X 7X2

CIUSSS de la Capitale-Nationale

525, boulevard Wilfrid-Hamel Est
Québec (Québec) G1M 2S8

CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec

3470, rue Sainte-Marguerite, pavillon G
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1X3

CIUSSS de l'Estrie

300, rue King Est, bureau 200
Sherbrooke (Québec) J1G 1B1

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
2305, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) H2H 1C5

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal
6300, rue Darlington
Montréal (Québec) H3S 2J4

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CRDP Constance-Lethbridge
7005, boulevard de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H4B 1T3

CHU Sainte-Justine

Centre de réadaptation Marie-Enfant
5200, rue Bélanger Est
Montréal (Québec) H1T 1C9

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Centre de réadaptation MAB Mackay
3500, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H4A 3J5

CIUSSS de l'Outaouais

135, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec) J8Y 6X7

CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue

CH SAT Amos
622, 4e Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2S2

FRANÇAIS

CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue

CRDP Rouyn-Noranda

7, 9e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

CIUSSS de l'Abitibi-Témiscamingue

CRDP Val-d'Or

915, rue Germain

Val-d'Or (Québec) J9P 3Y1

CIUSSS de la Côte-Nord

1250, rue Lestat

Baie-Comeau (Québec) G5C 1T8

CIUSSS DE LA Gaspésie

230, route du Parc

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2C4

CIUSSS de Chaudière-Appalaches

9500, boulevard du Centre-Hospitalier

Charny (Québec) G6X 0A1

CIUSSS de Laval

Hôpital juif de réadaptation de Laval

560, boulevard Cartier Ouest

Laval (Québec) H7V 1J1

CIUSSS de Lanaudière

1075, boulevard Firestone, bureau 1000

Joliette (Québec) J6E 6X6

CIUSSS des Laurentides

11, rue Boyer

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2K5

CIUSSS Montérégie-Ouest

5300, chemin de Chambly

Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N7

7. Rangement et Expédition

Rangement

Recommandations générales

- La base de positionnement doit être rangée dans un endroit propre et sec, loin des objets pointus qui pourraient l'endommager.
- Si votre base de positionnement est entreposée depuis quelques semaines, référez-vous à la section Liste de vérification et procédez à une vérification approfondie avant utilisation. Il est important de vérifier que chaque composant de votre base de positionnement fonctionne normalement. Au besoin, procédez à l'entretien recommandé dans le guide.
- Si la base de positionnement a été rangée pendant plus de (2) deux mois, une inspection par un fournisseur agréé est requise.
- Il est fortement recommandé de ne pas laisser durant des périodes prolongées la base de positionnement à l'extérieur lors d'intempéries telles que sous la neige, la pluie ou le verglas. Il est déconseillé également que la base de positionnement soit rangée dans un endroit extrêmement humide ainsi que sous des températures extrêmement froides dans le but d'éviter tous bris ou d'endommager le fauteuil.

Expédition

Pour expédier votre base de positionnement sécuritairement, veuillez suivre les recommandations suivantes.

- Utilisez une boîte de déménagement robuste avec des dimensions d'environ 5 po (130 mm) de plus que les dimensions hors-tout de votre base de positionnement.
- Bien envelopper celle-ci dans de l'emballage à bulle ou un matériel de matelassage.
- Remplissez la boîte de matériel d'emballage pour limiter le mouvement de la base dans la boîte.



AVERTISSEMENT

Avant utilisation de la base de positionnement, il est important de procéder à une vérification de ses composants.

FRANÇAIS

8. Garantie

Les Équipements adaptés Physipro Inc. s'oblige à maintenir en bonne condition d'utilisation les appareils, leurs composants et leurs pièces et à remédier, à ses frais, à tout défaut de conception ou de fabrication, panne ou fonctionnement inadéquat. Cette garantie s'applique aux appareils, aux composants et aux pièces et elle couvre à la fois les pièces et la main-d'œuvre requises pour effectuer la réparation. La garantie inclut également tous les frais d'administration et de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de son exécution.

De façon plus spécifique, Les Équipements adaptés Physipro Inc. s'engage à donner les durées de garanties suivantes :

a) une garantie de douze (12) mois à compter de la date de prise de possession par la personne assurée sur les appareils et leurs composants, à l'exception :

I. du châssis pour lequel la garantie s'établit comme suit :

- i. ☐ fauteuil roulant à propulsion manuelle (châssis rigide) : à vie;
- ii. ☐ fauteuil roulant à propulsion manuelle (châssis pliant) : 5 ans;
- iii. ☐ fauteuil roulant à propulsion motorisée : 5 ans;
- iv. ☒ base de positionnement : 5 ans.

II. des pneus, des chambres à air, des garnitures de confort, des accoudoirs, des revêtements de siège et de dossier et des roulements à billes pour lesquels la garantie est de trente (30) jours.

Les appareils et les composants faisant l'objet d'un remplacement ou d'une réparation en application de l'une de ces garanties demeurent assujettis à celle-ci pour sa durée restante.

Toutefois, les composants remplacés ou réparés en application d'une garantie dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son expiration sont garantis quatre-vingt-dix (90) jours, à l'exception de ceux remplacés ou réparés en application de la garantie prévue au sous-paragraphe II dans les trente (30) jours de l'expiration de leur garantie, lesquels sont alors garantis trente (30) jours.

b) Une garantie de remplacement sans frais, dans l'année de la prise de possession par la personne assurée, d'un appareil ou d'un composant qui a fait l'objet de quatre (4) réparations pour une même défectuosité ou non ou qui est hors d'usage pour une durée de soixante (60) jours, consécutifs ou non.

Le décompte commence au premier jour où l'appareil ou le composant est hors d'usage. Une intervention de réparation effectuée dans une journée, quelle que soit sa durée, compte pour un jour. Cependant, le fournisseur n'est pas imputable des délais attribuables au manque de disponibilité de la personne assurée ou de l'établissement pour effectuer la réparation.

Un appareil ou un composant est considéré hors d'usage lorsqu'il n'est pas en état de servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Les pièces utilisées pour réparer un appareil ou un composant se voient appliquer la garantie résiduelle de cet appareil ou de ce composant.

Limite des garanties :

Les garanties ne couvrent aucun dommage :

i. attribuable à l'installation d'un composant ou d'une pièce provenant d'un tiers ou d'un fabricant non autorisé par le fournisseur;

ii. causé par un tiers ou un fabricant non autorisé par le fournisseur;

iii. découlant d'un usage abusif ou de l'utilisation non conforme aux consignes d'utilisation et d'entretien énoncées dans le manuel de l'utilisateur.

Les remplacements et les réparations effectués durant les périodes de garantie doivent l'être avec des pièces et des composants d'origine.

Les Équipements adaptés Physipro Inc. est responsable du respect des garanties.

Notes :

[illegible]



PHYSIPRO

www.physipro.com

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Canada



LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com

Europe



Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr